

terça 14/07

DDT 10,3U


Índice basal total 40% | 4,1U

Bolus total 60% | 6,2U

{ Bolus 89% | 5,5U

+ Correção autom. 11% | 0,7U

Tempo no intervalo

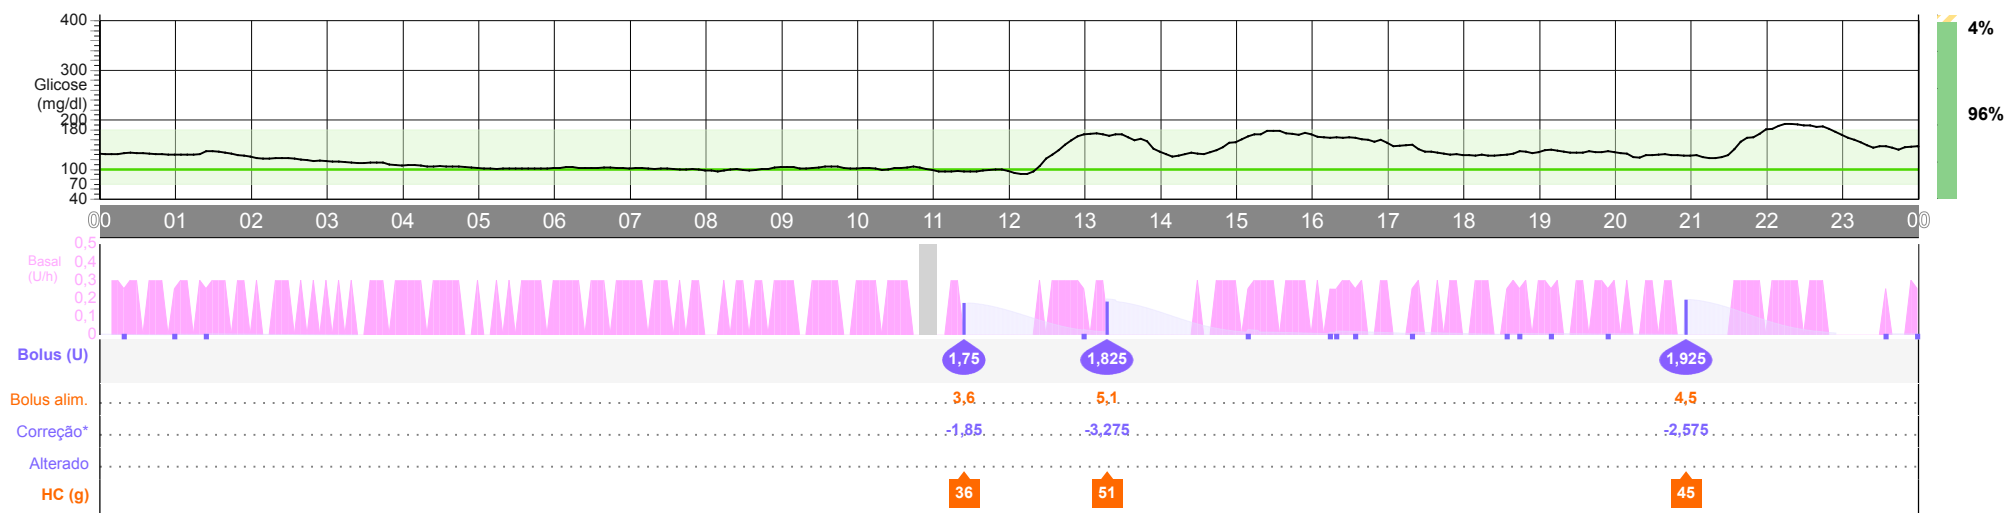

quarta 15/07

DDT 10,3U


Índice basal total 31% | 3,2U

Bolus total 69% | 7,1U


{ Bolus 93% | 6,6U

+ Correção autom. 7% | 0,5U

Tempo no intervalo

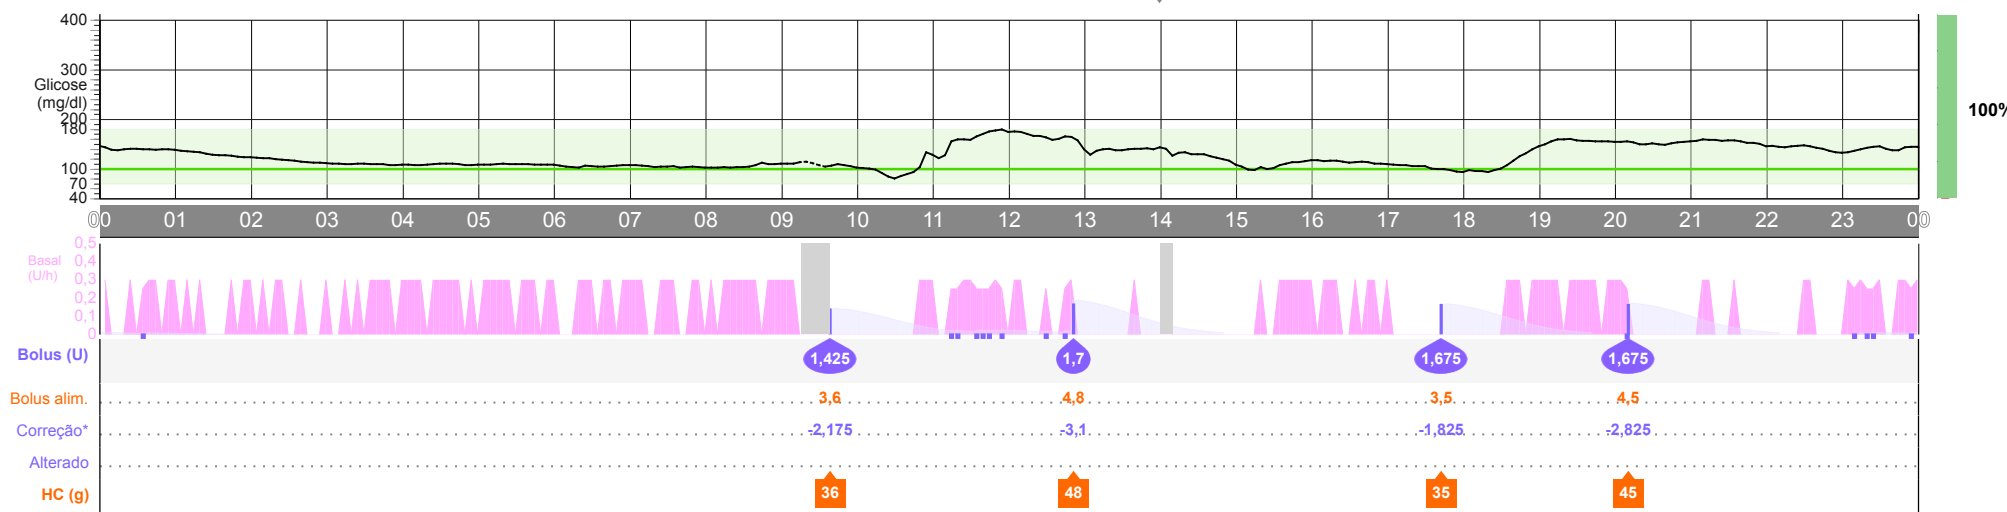

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.



quinta 16/07

DDT 11,4U


Índice basal total 31% | 3,5U

Bolus total 69% | 7,9U

{ Bolus 86% | 6,8U

+ Correção autom. 14% | 1,1U

Tempo no intervalo

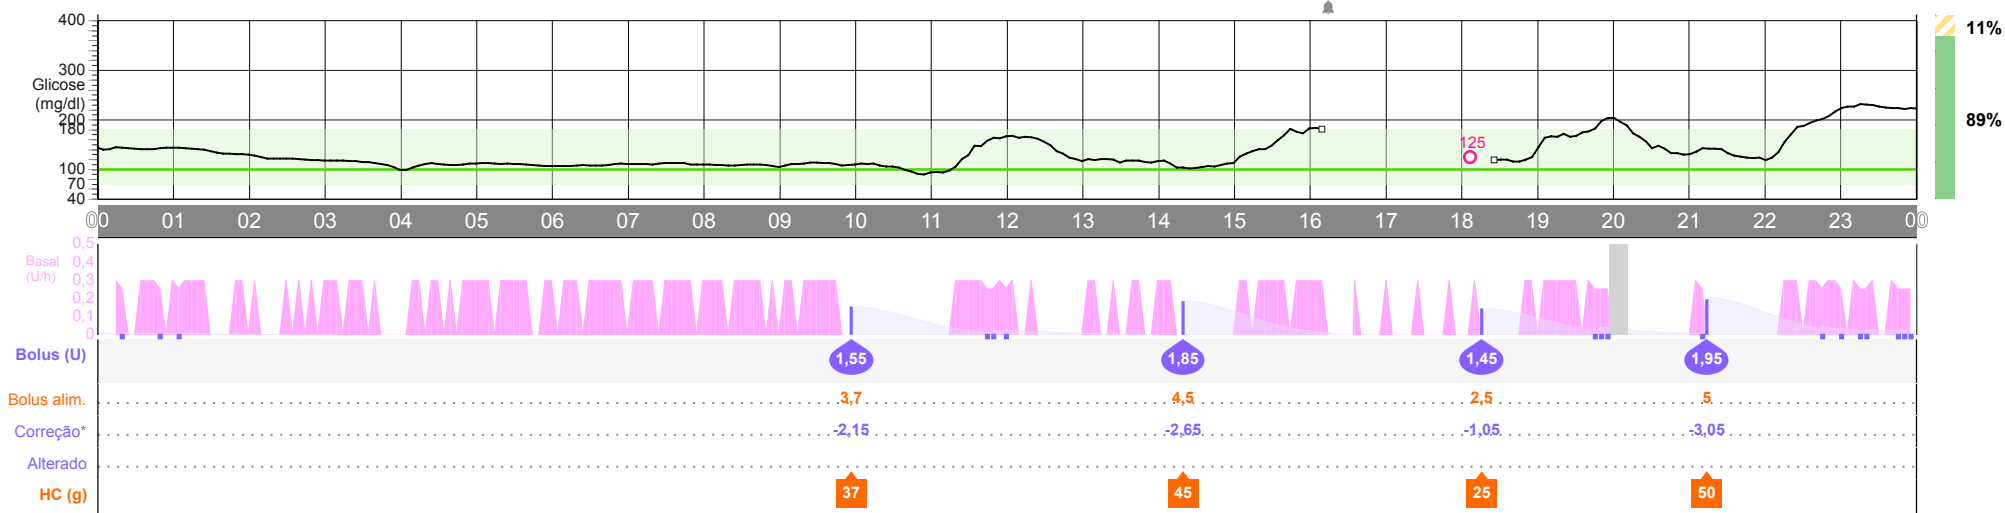

sexta 17/07

DDT 8,3U


Índice basal total 36% | 3,0U

Bolus total 64% | 5,3U

{ Bolus 89% | 4,7U



+ Correção autom. 11% | 0,6U

Tempo no intervalo

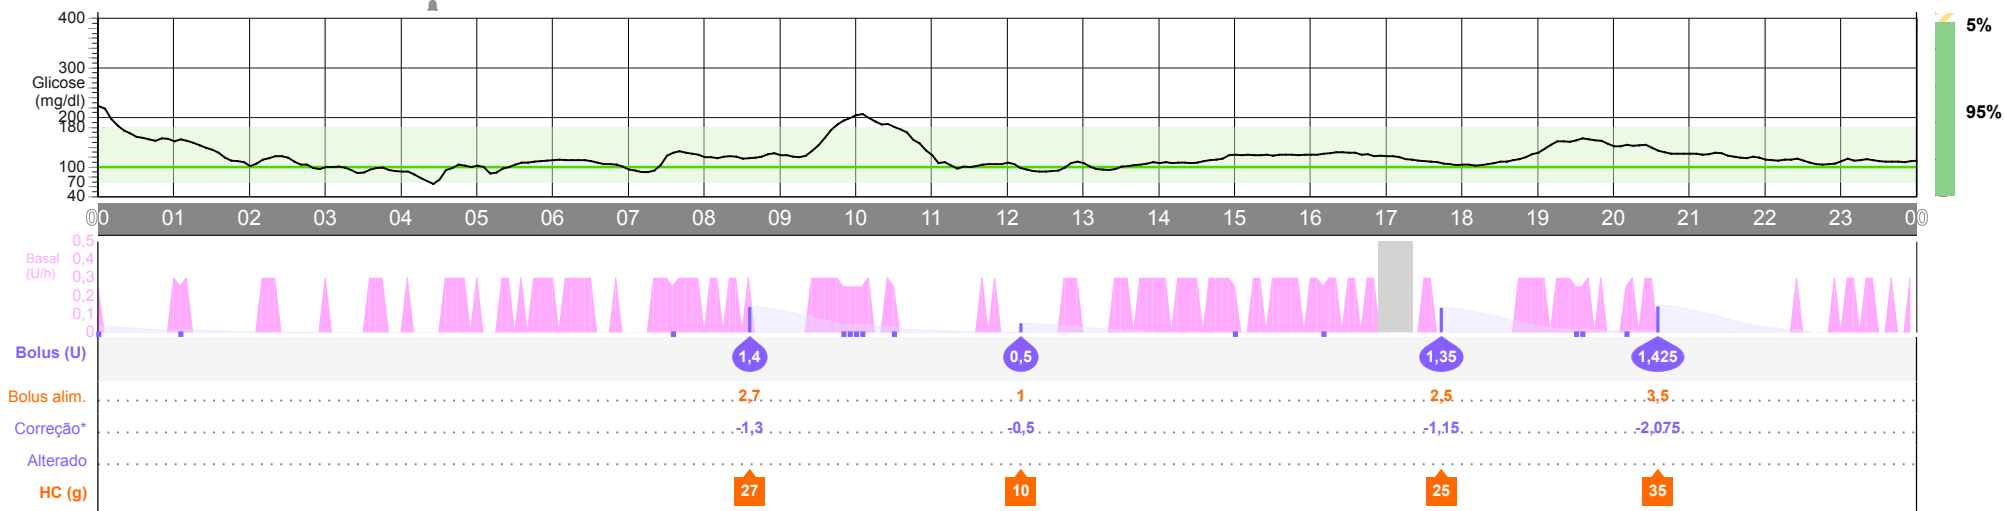

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.



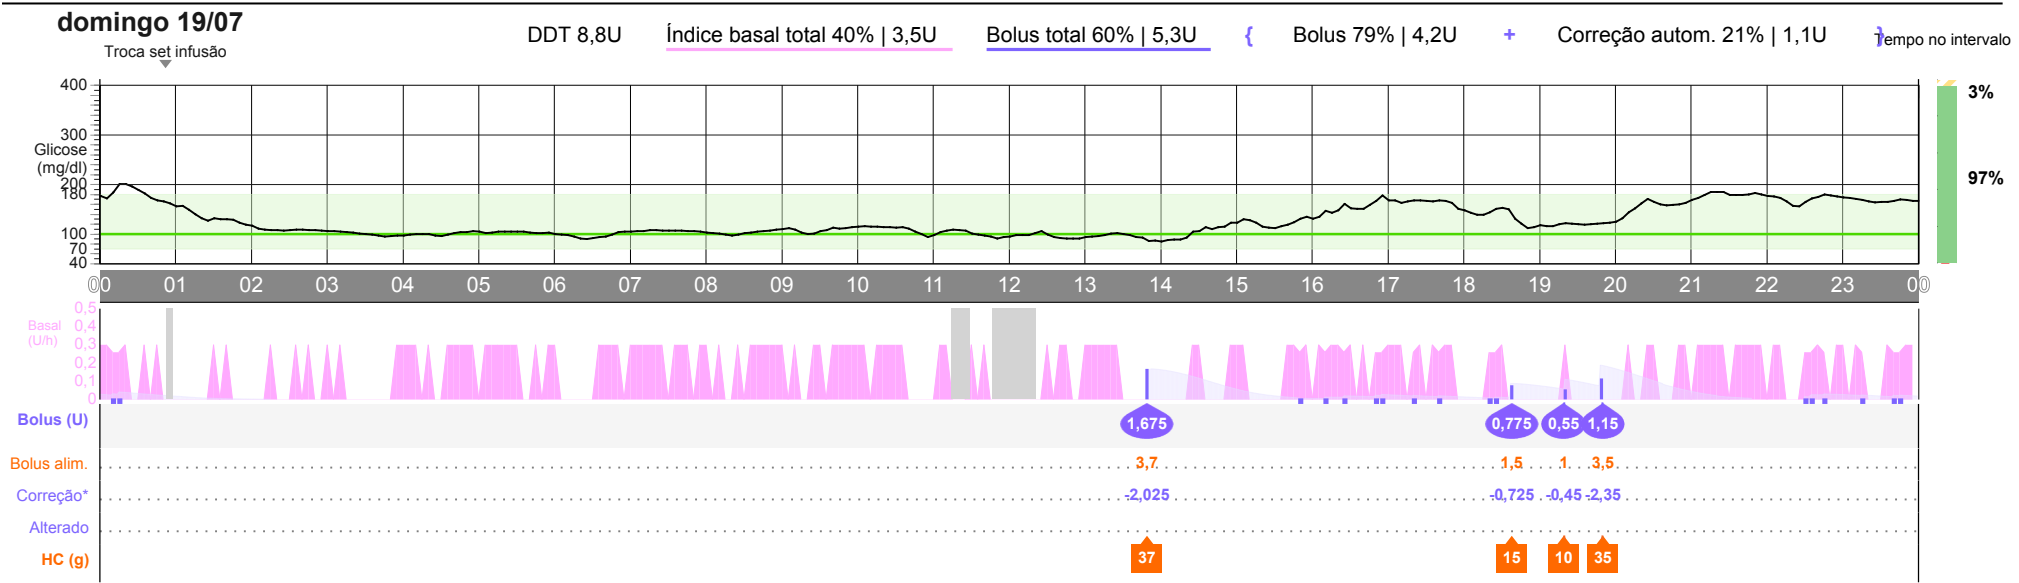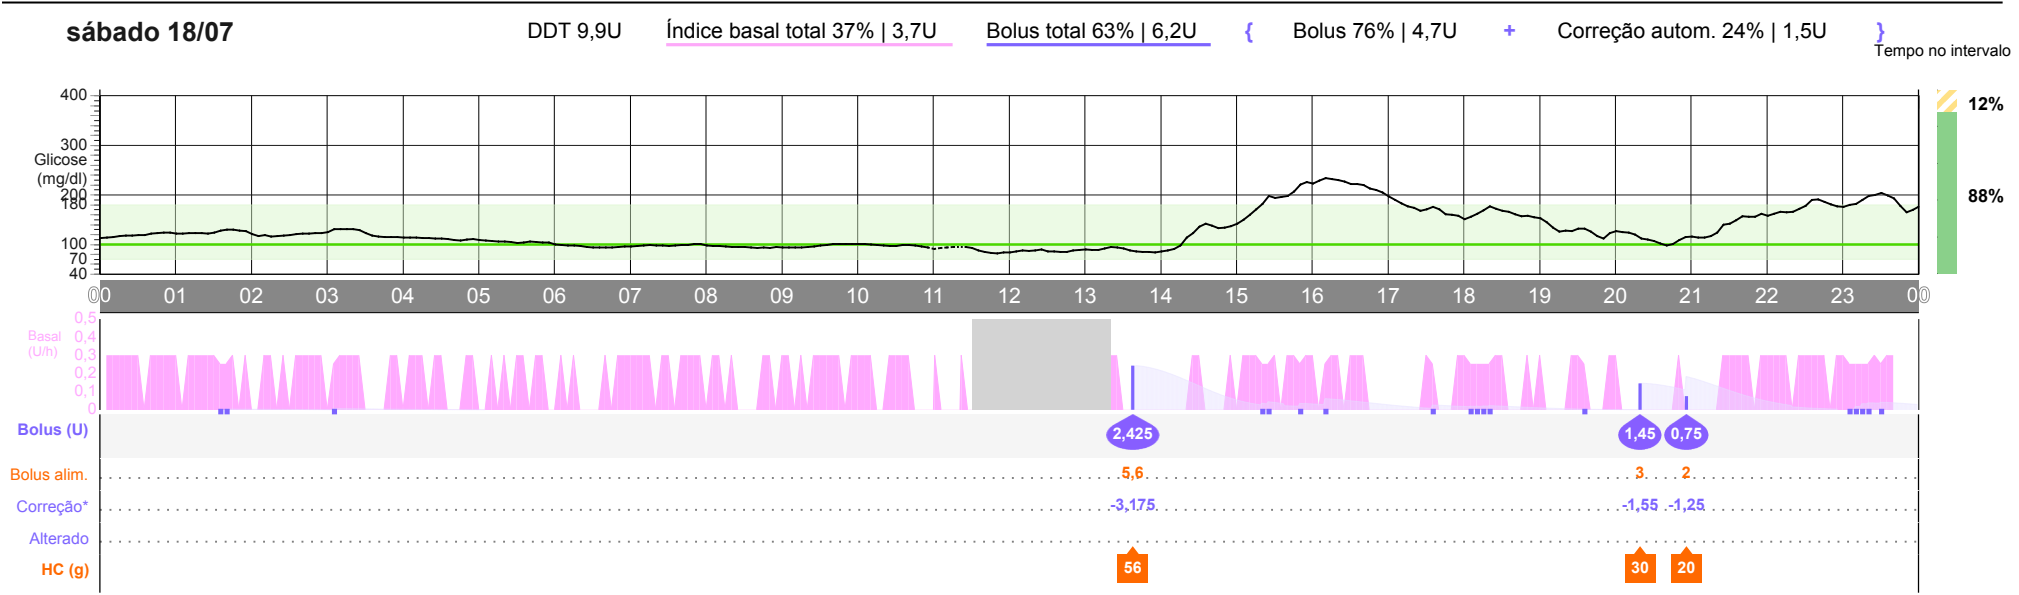

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.

segunda 20/07

DDT 10,5U


Índice basal total 35% | 3,7U

Bolus total 65% | 6,8U

{ Bolus 84% | 5,7U

+ Correção autom. 16% | 1,1U

Tempo no intervalo

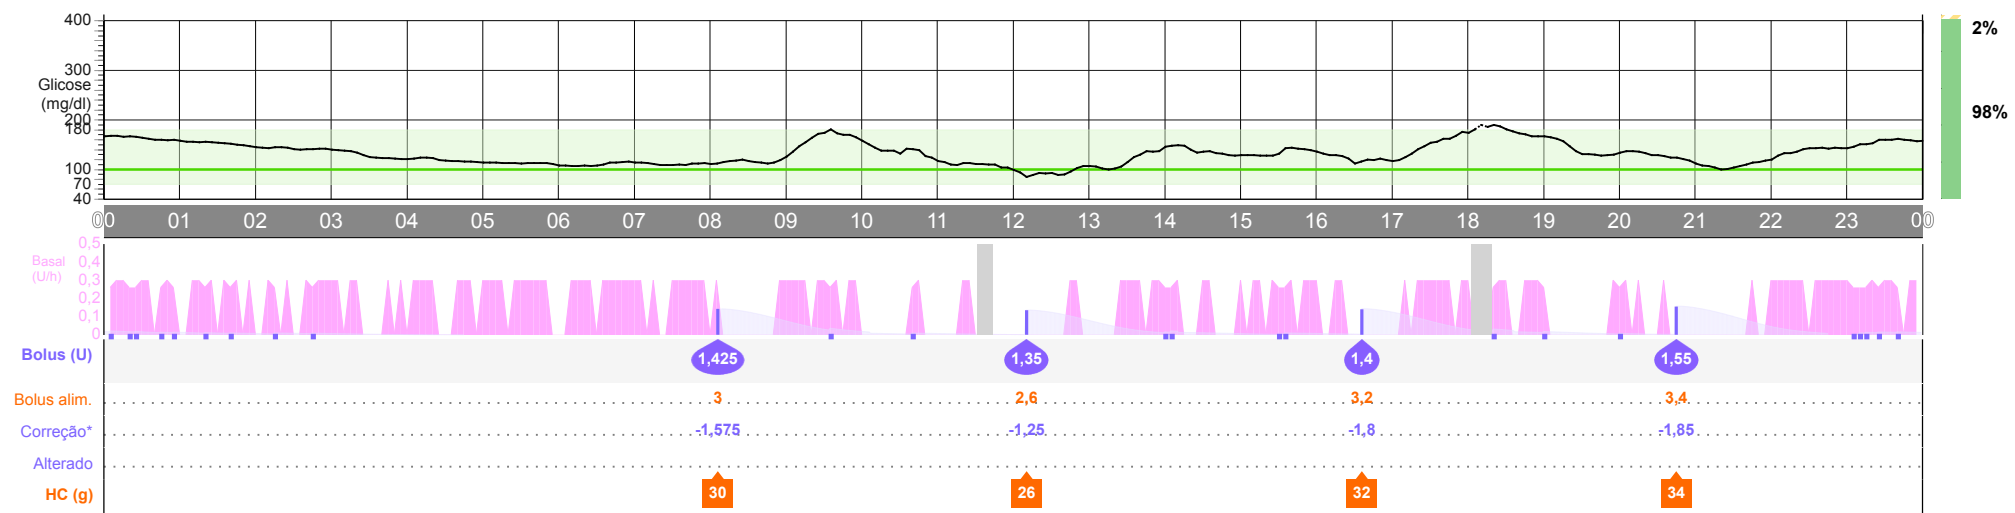

terça 21/07

DDT 10,4U


Índice basal total 38% | 4,0U

Bolus total 62% | 6,4U

{ Bolus 88% | 5,6U



+ Correção autom. 13% | 0,8U

Tempo no intervalo

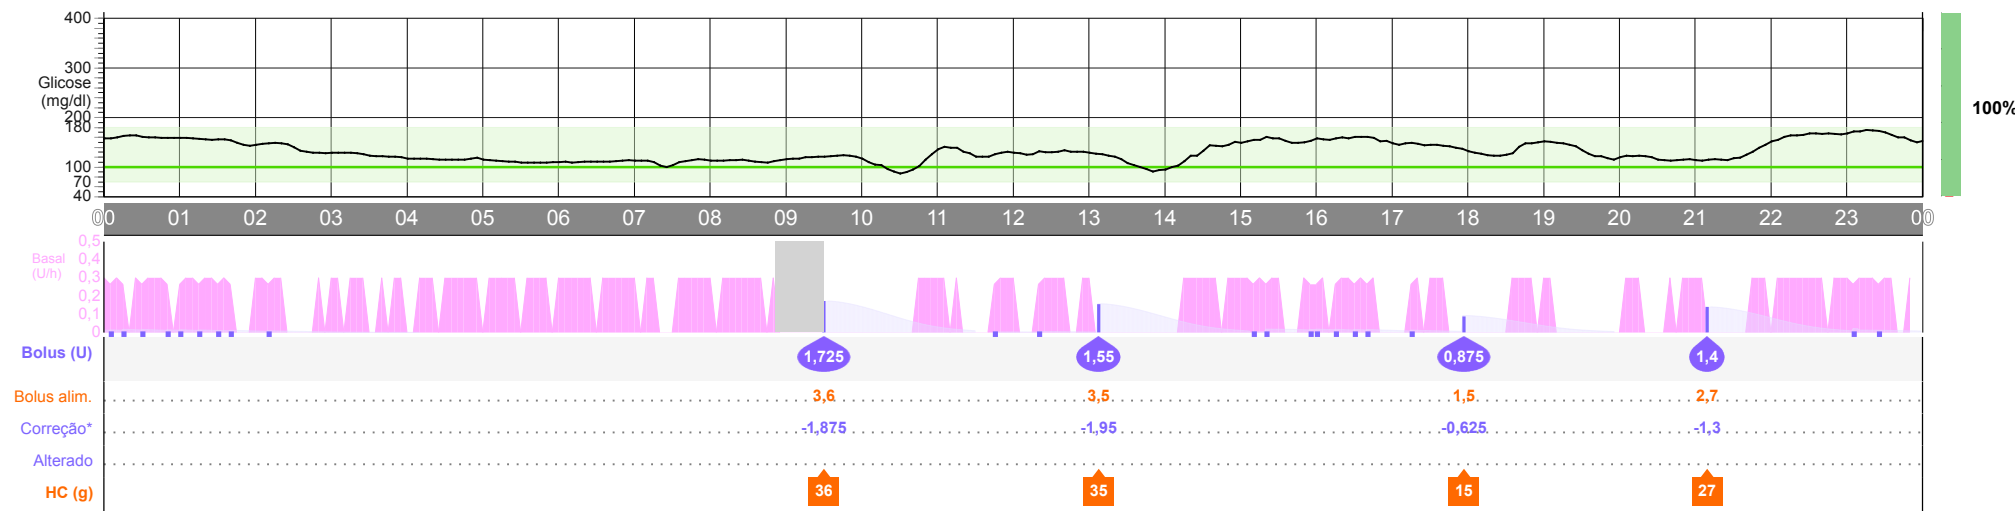

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.



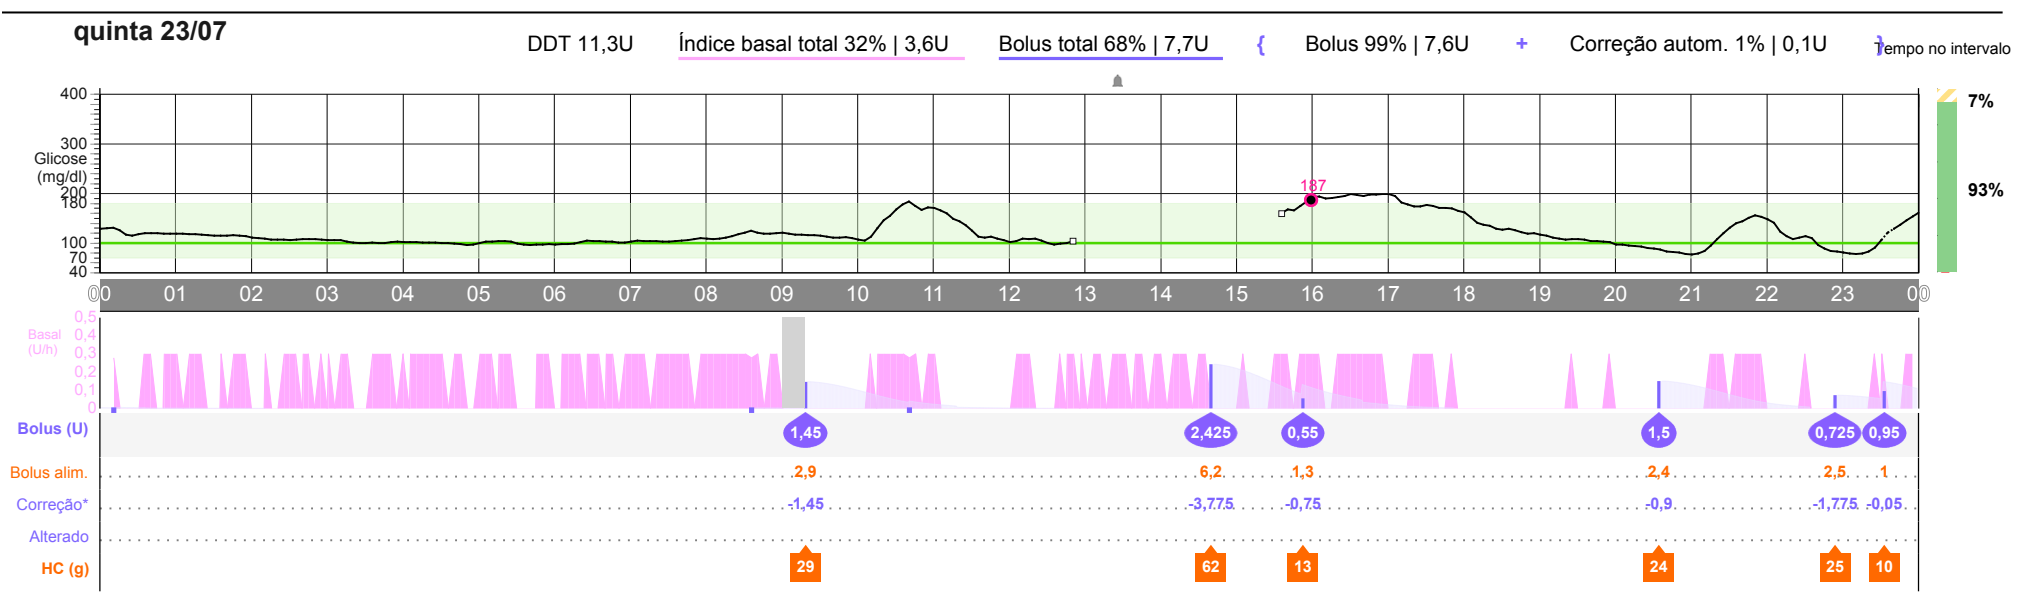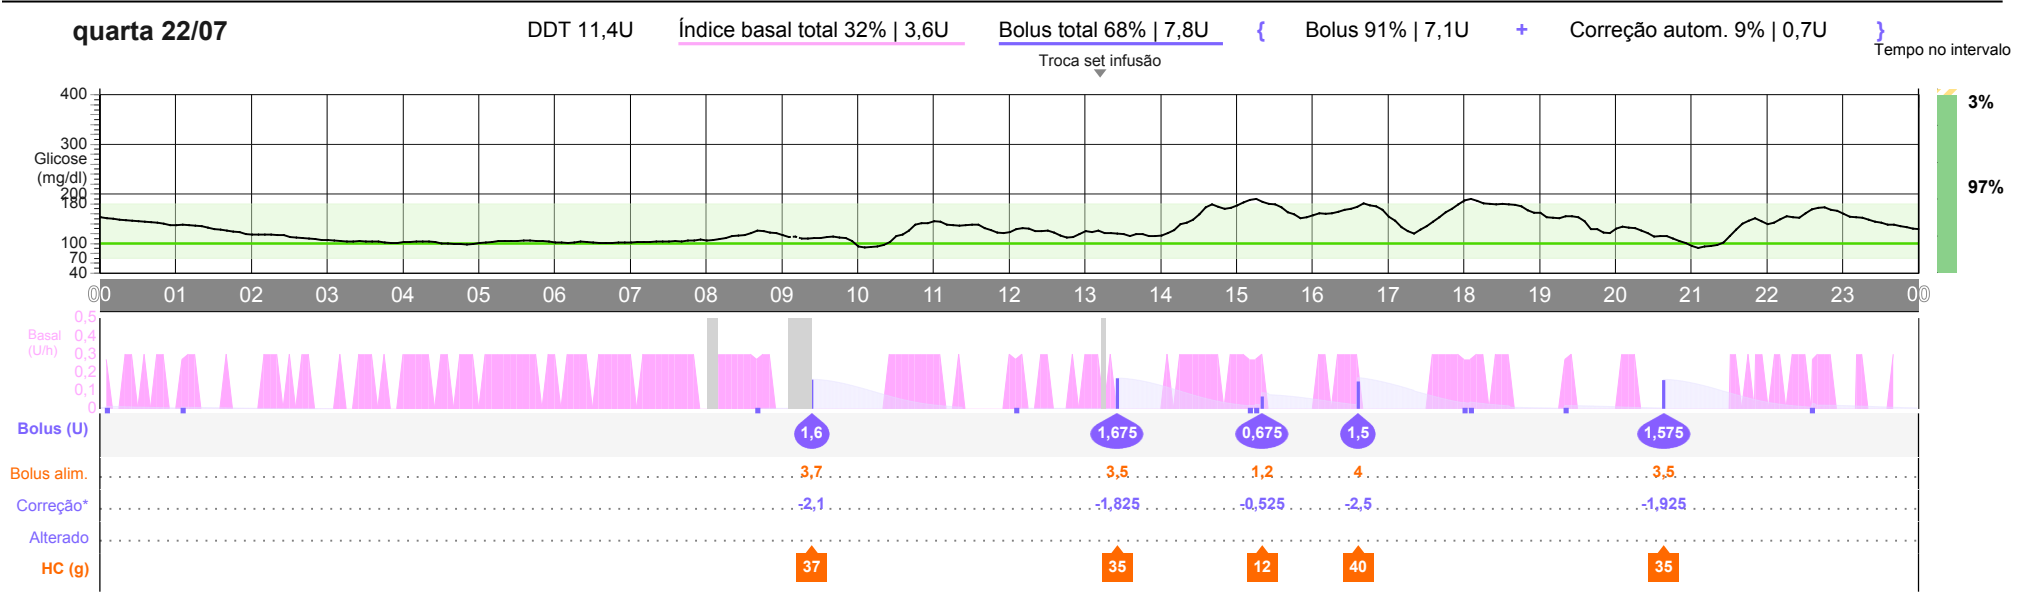

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.

sexta 24/07

DDT 10,7U

Índice basal total 35% | 3,7U


Bolus total 65% | 7,0U

{ Bolus 81% | 5,7U

+ Correção autom. 19% | 1,3U

Tempo no intervalo

Troca set infusão

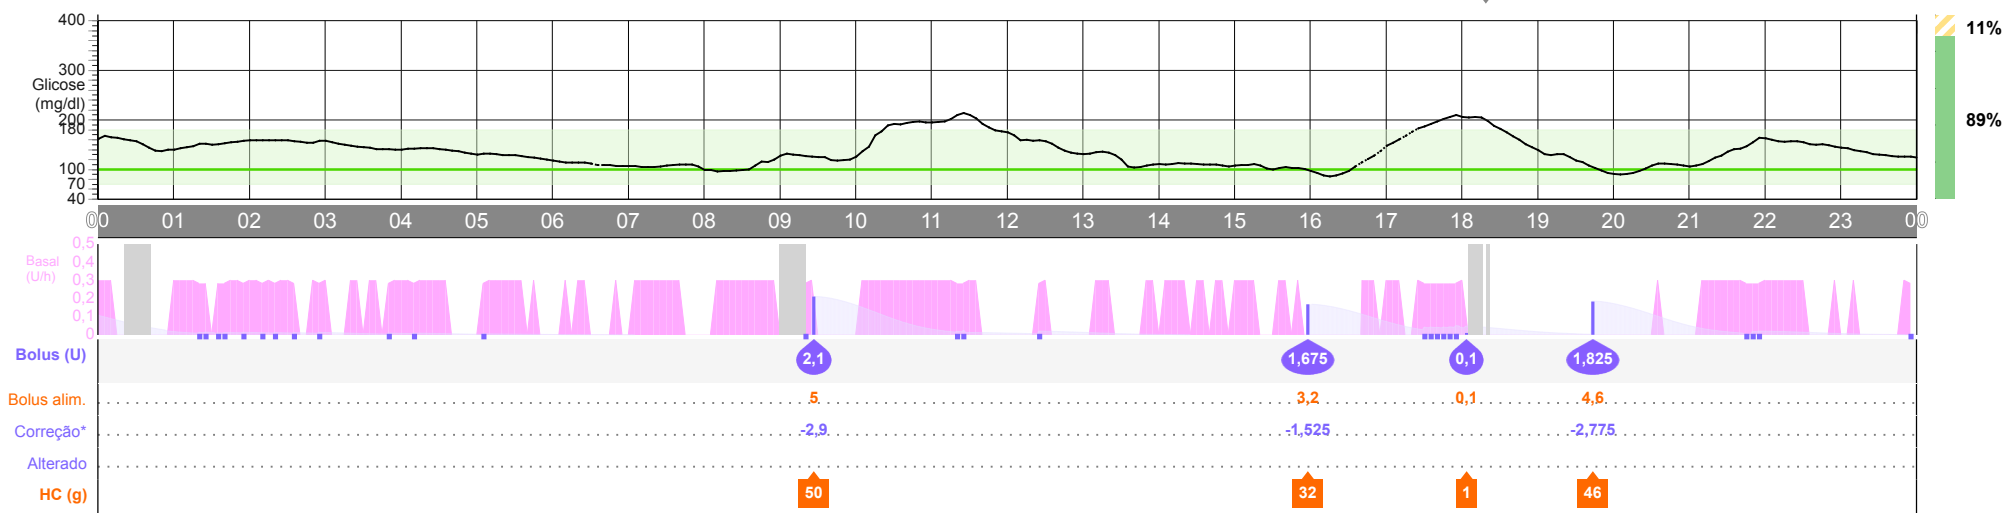

sábado 25/07

DDT 11,4U


Índice basal total 24% | 2,7U

Bolus total 76% | 8,7U

{ Bolus 97% | 8,4U



+ Correção autom. 3% | 0,3U

Tempo no intervalo

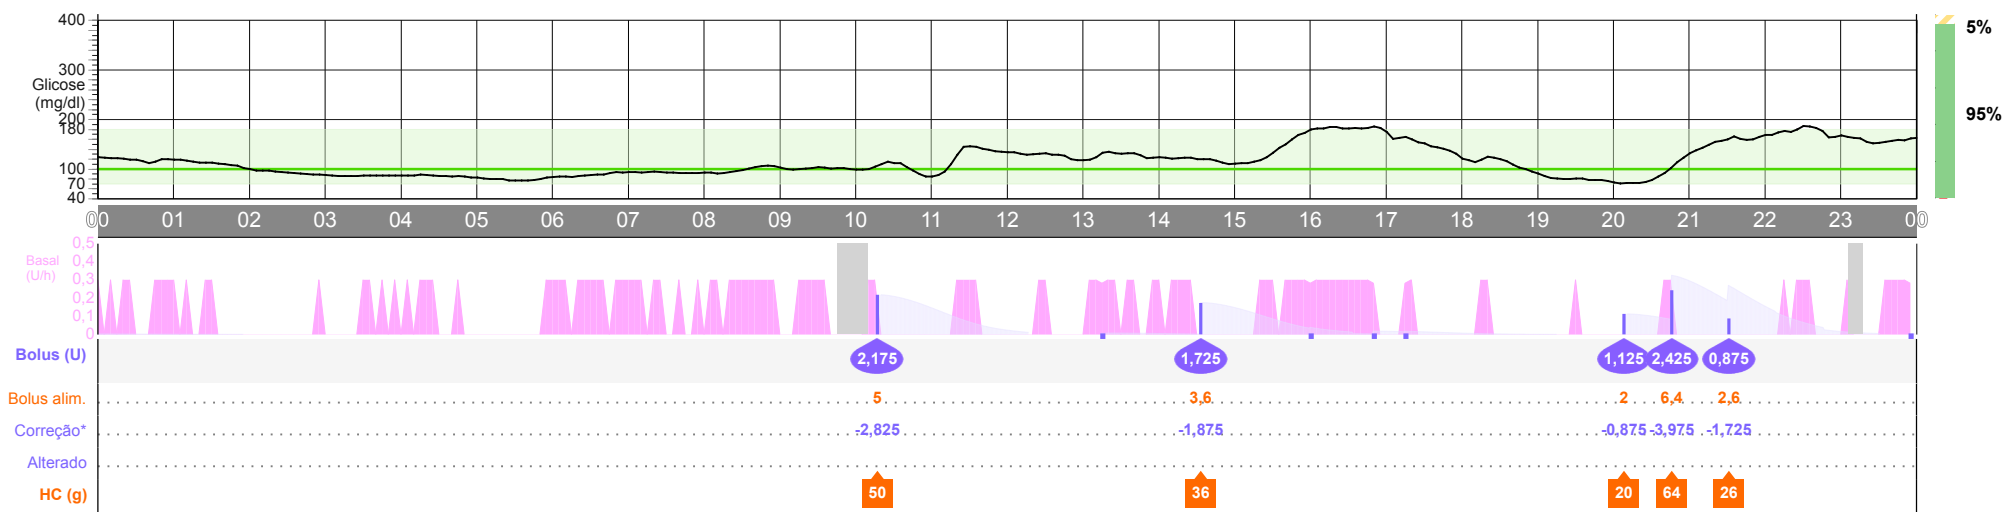

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.



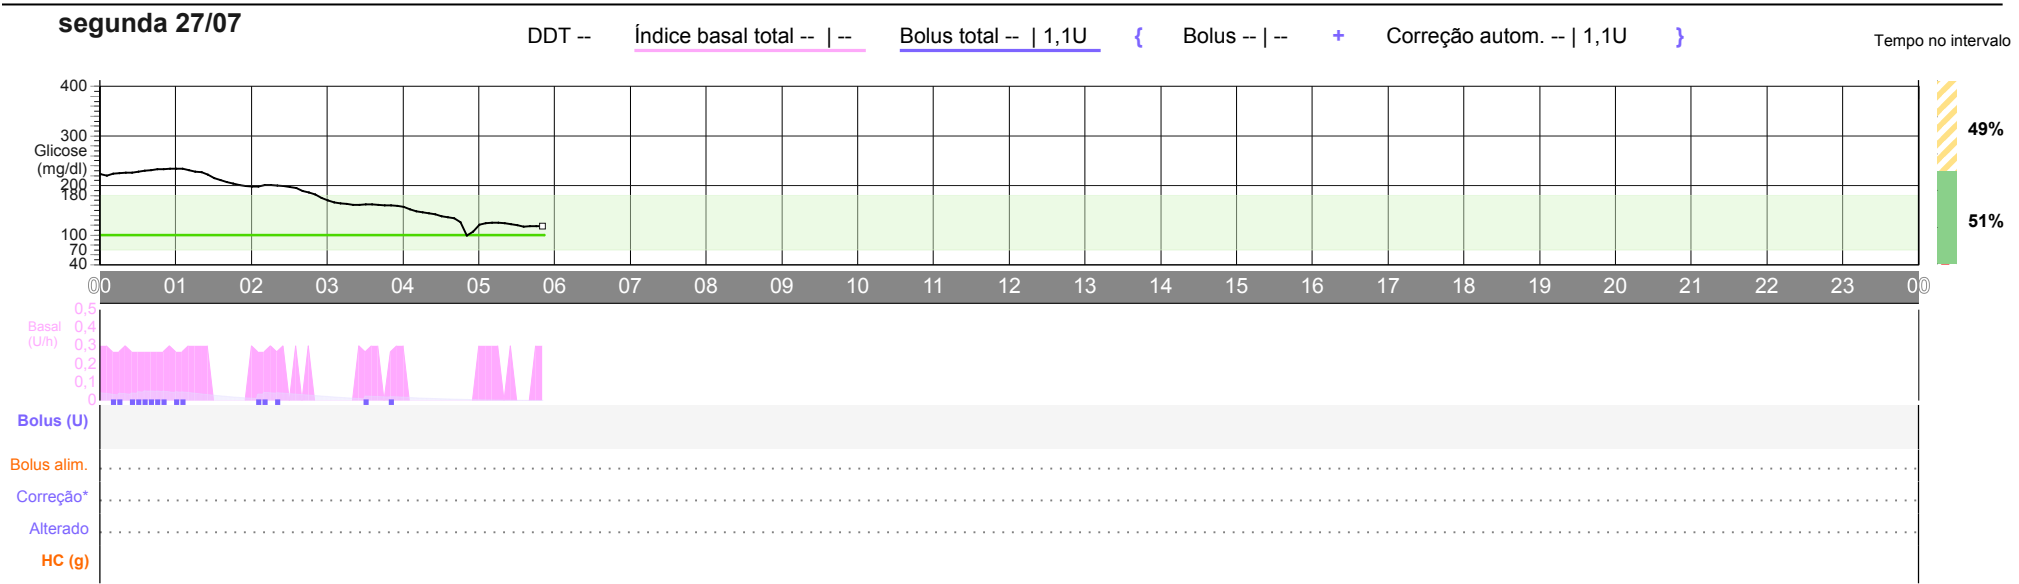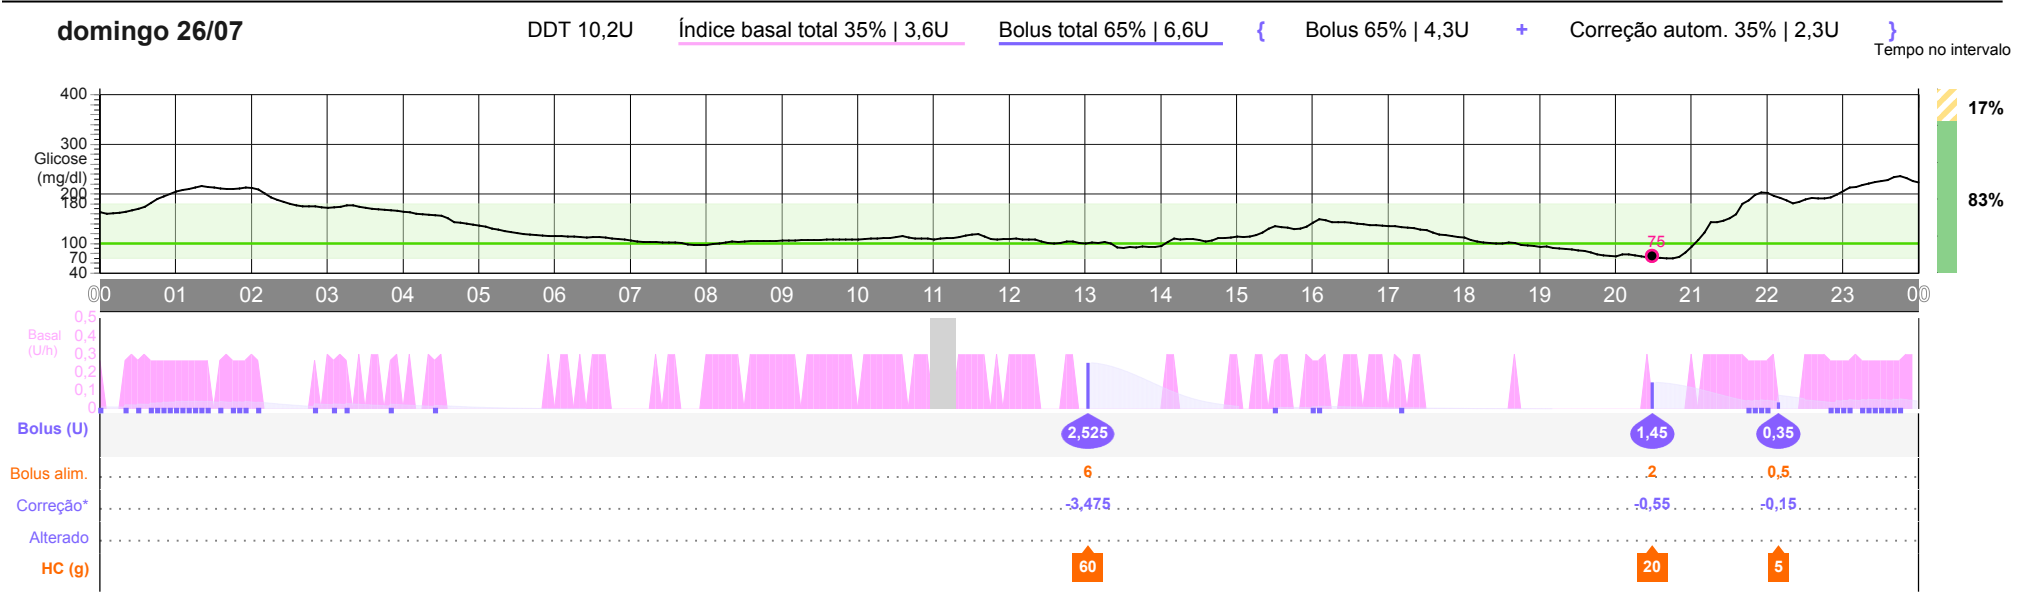

*Insulina ativa considerada. O SmartGuard também considera o ajuste do bolus SmartGuard.