Jueves 16/07

DDT 11,4 U | Basal total 31 % | 3,5 U | Bolus total 69 % | 7,9 U { Bolus 86 % | 6,8 u + Autocorrección 14 % | 1,1 u }

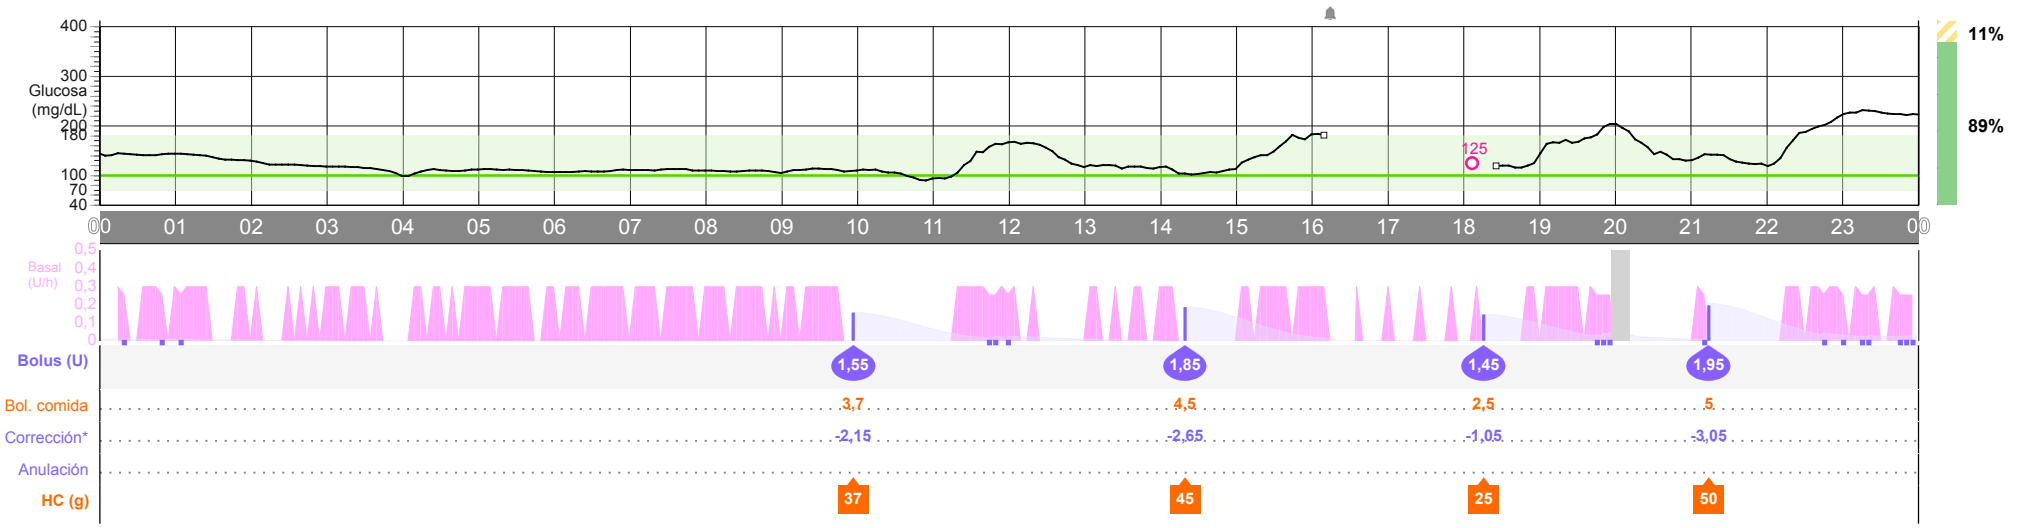

Viernes 17/07

DDT 8,3 U | Basal total 36 % | 3,0 U | Bolus total 64 % | 5,3 U { Bolus 89 % | 4,7 u + Autocorrección 11 % | 0,6 u }

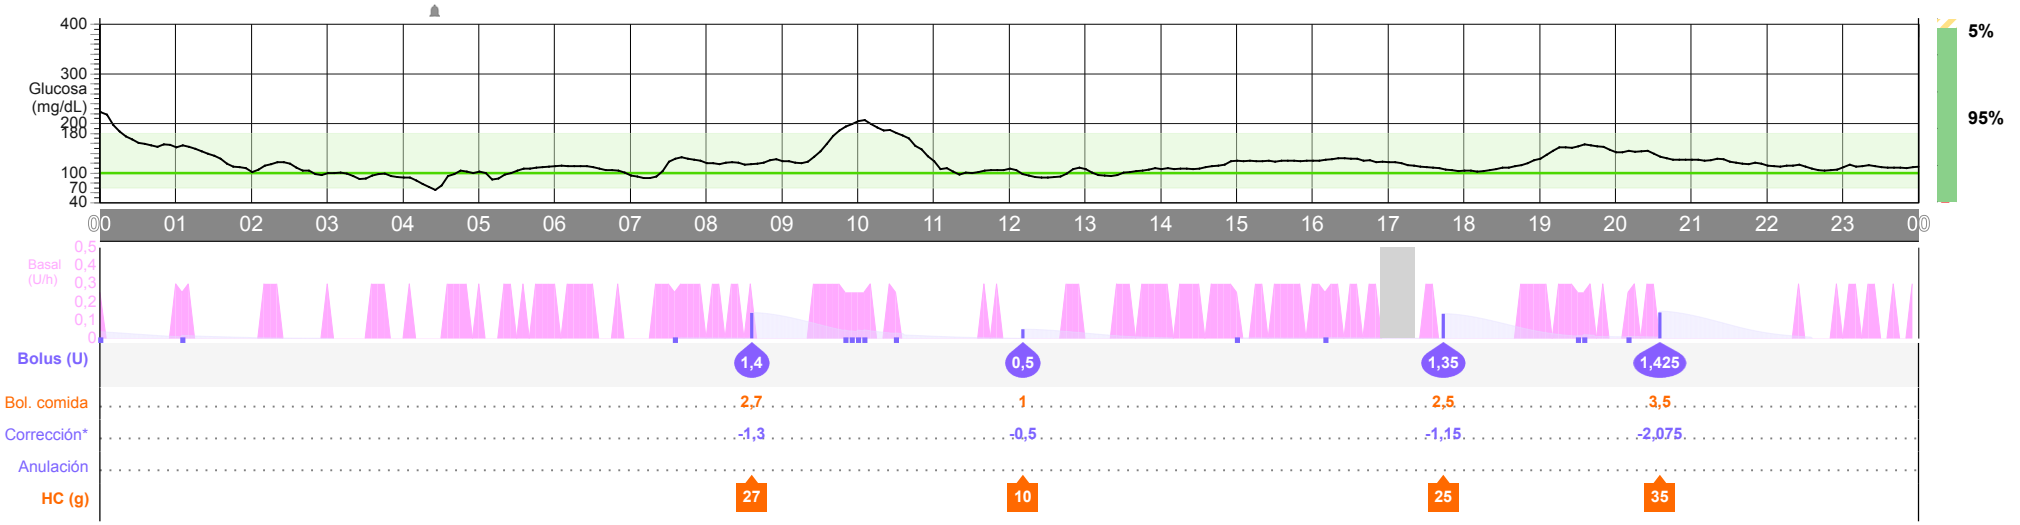

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.



Sábado 18/07

DDT 9,9 U | Basal total 37 % | 3,7 U | Bolus total 63 % | 6,2 U { Bolus 76 % | 4,7 u + Autocorrección 24 % | 1,5 u }

Tiempo en rango

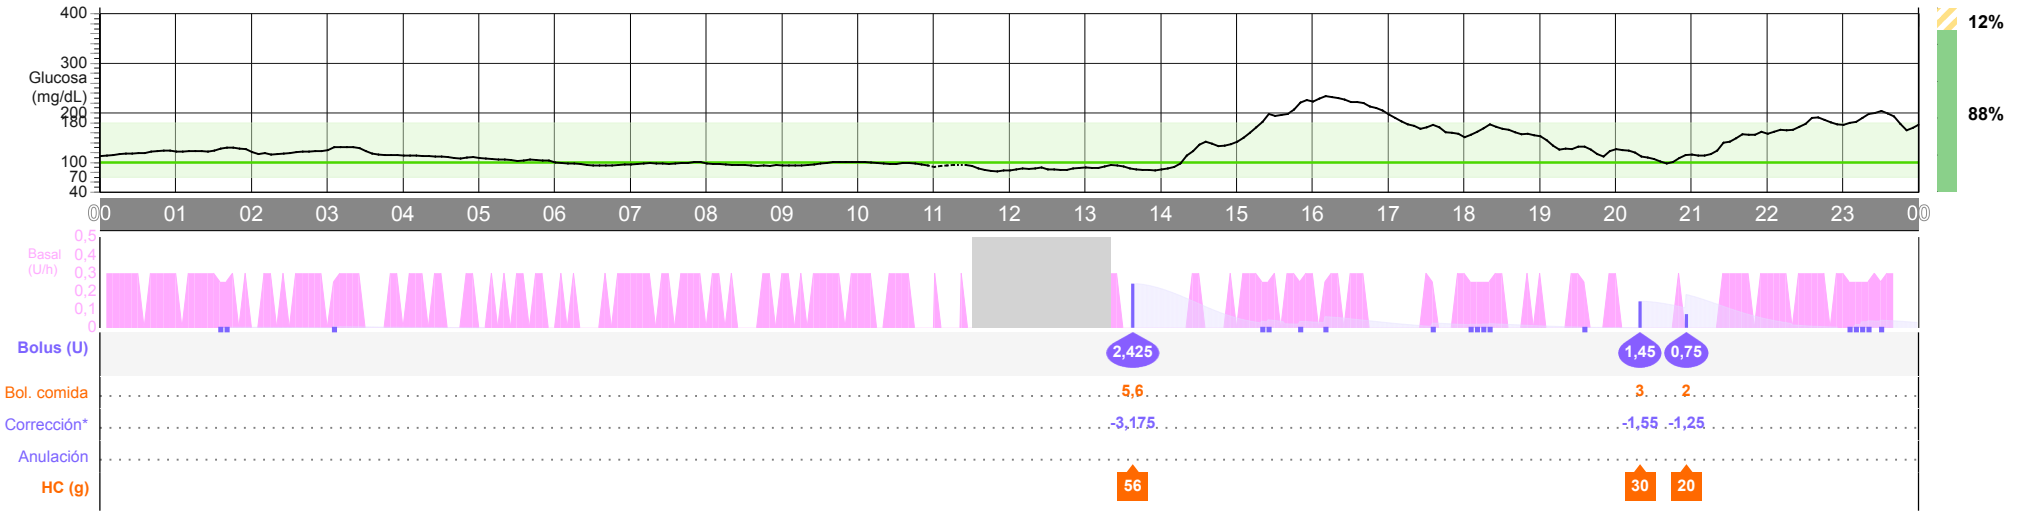

Domingo 19/07

Cambiar eq. infusión

DDT 8,8 U | Basal total 40 % | 3,5 U | Bolus total 60 % | 5,3 U { Bolus 79 % | 4,2 u + Autocorrección 21 % | 1,1 u }

Tiempo en rango

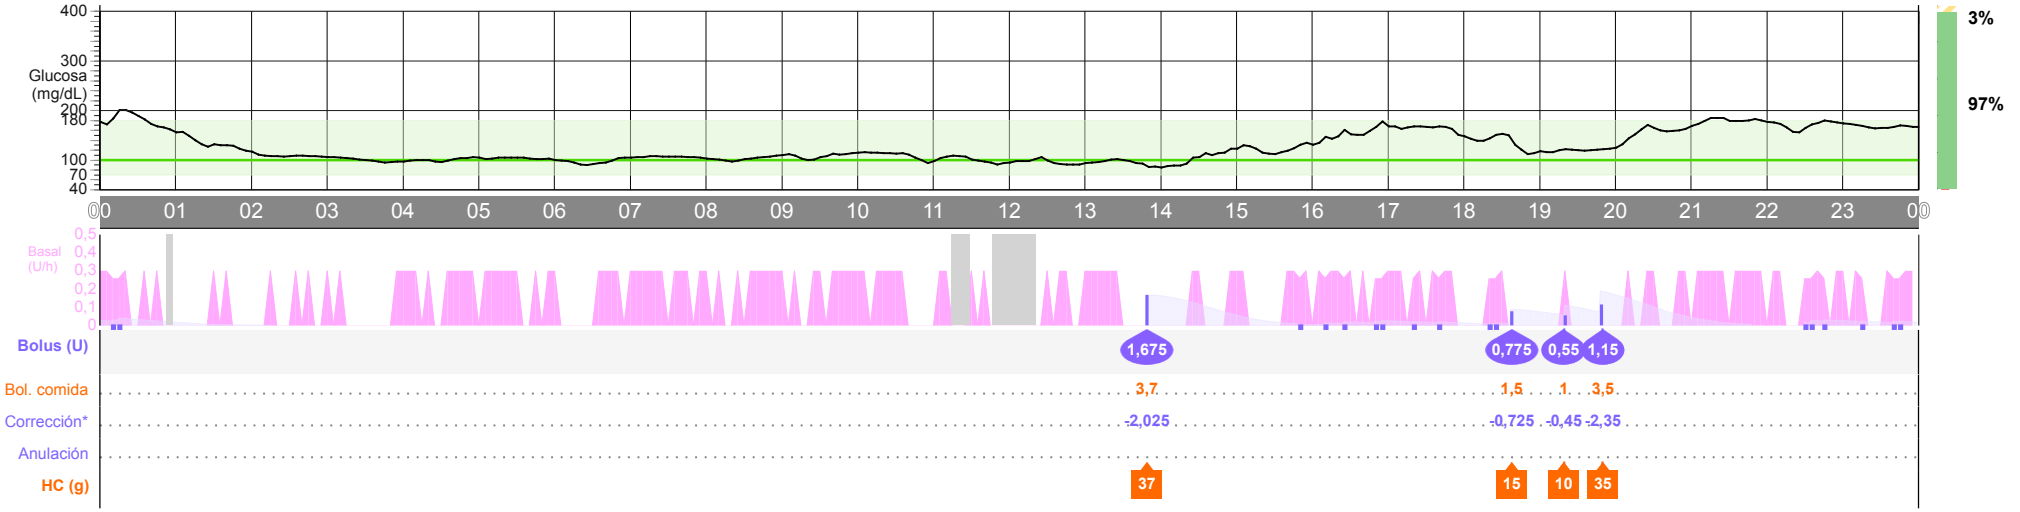

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual

Tiempo en rango (mg/dL) 50 70 180 250

Lunes 20/07

DDT 10,5 U | Basal total 35 % | 3,7 U | Bolus total 65 % | 6,8 U { Bolus 84 % | 5,7 u + Autocorrección 16 % | 1,1 u }

Tiempo en rango

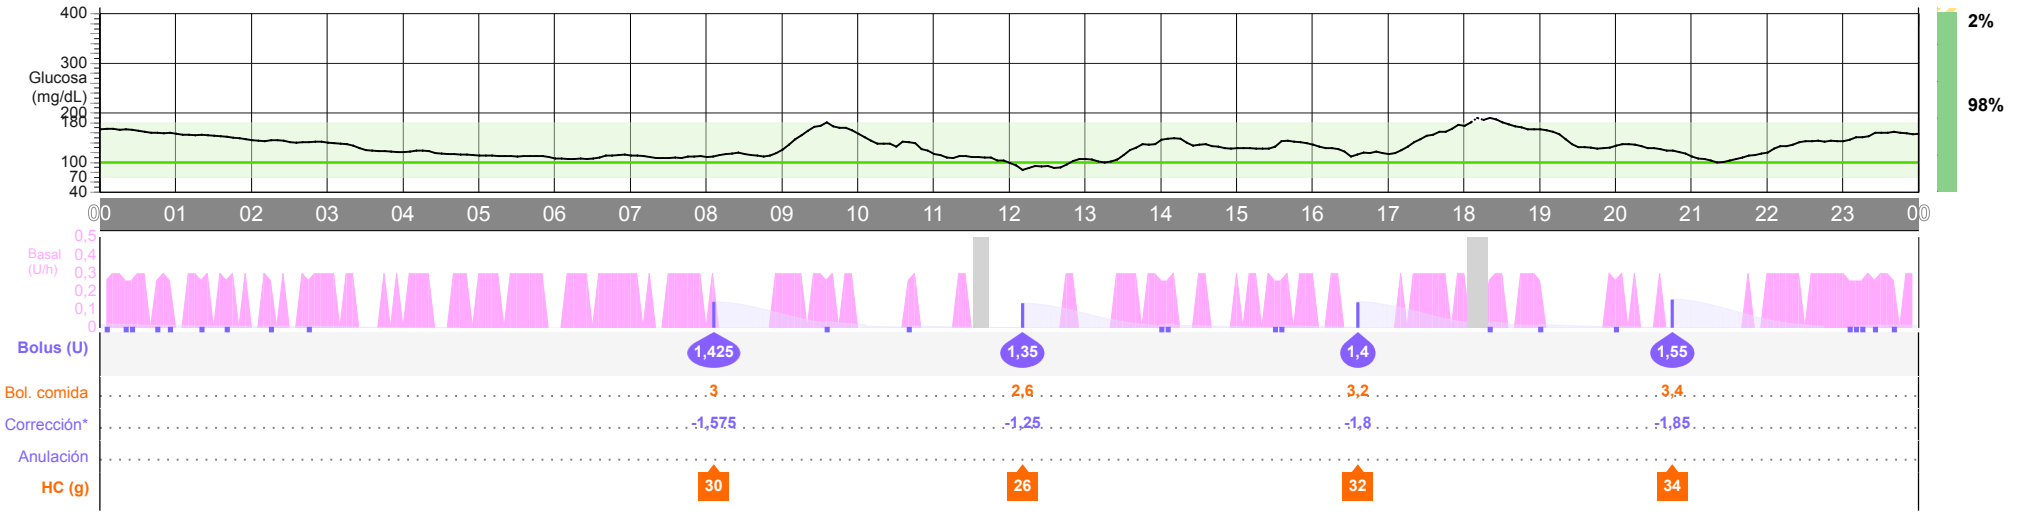

Martes 21/07

DDT 10,4 U | Basal total 38 % | 4,0 U | Bolus total 62 % | 6,4 U { Bolus 88 % | 5,6 u + Autocorrección 13 % | 0,8 u }

Tiempo en rango

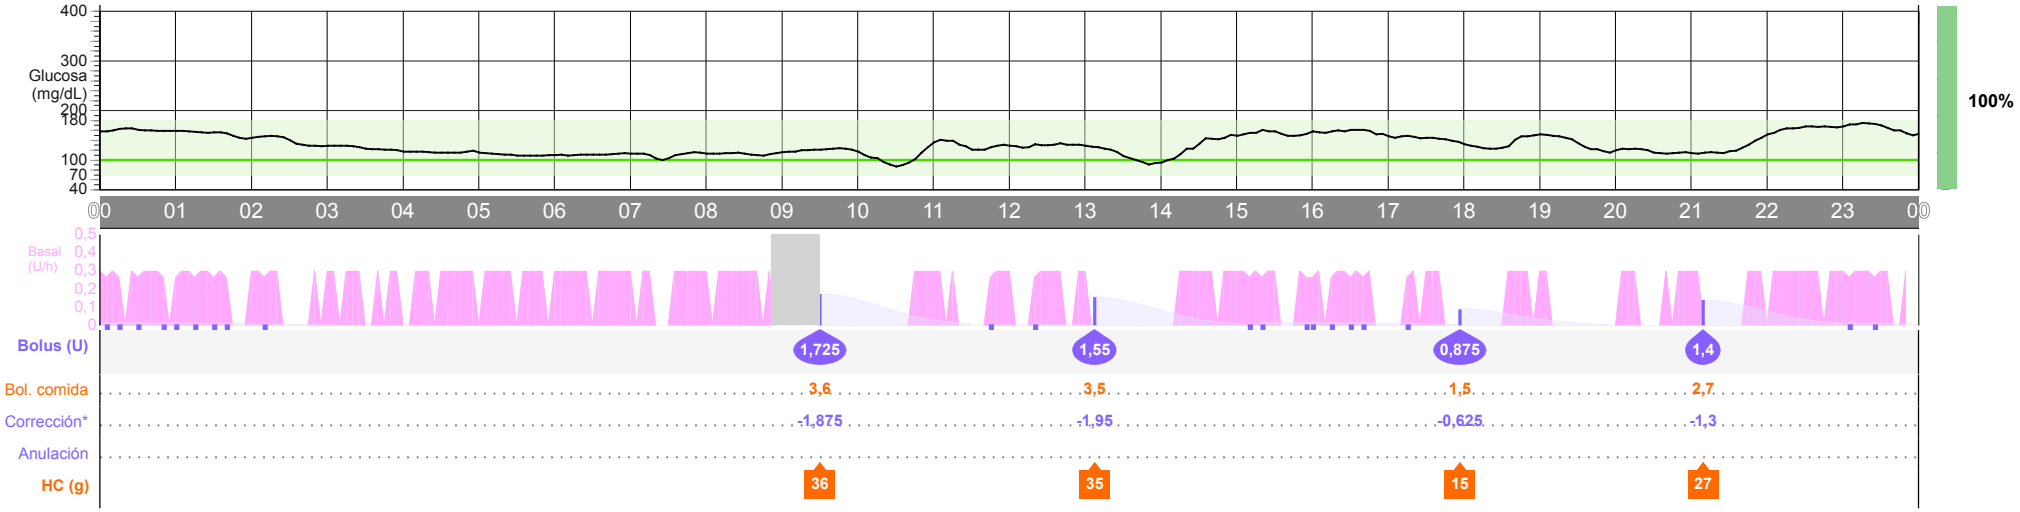

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre
Calibración
Autobasal
Susp. límite bajo
Basal
Susp. antes lím. bajo
Basal temporal
Alertas
Autocorrección + Insulina activa
Retr. rec. sensor
Bolus + Insulina activa
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Fuera gráfico
Modo Manual
Suspensión manual
Tiempo en rango (mg/dL)
50 70 180 250

Miércoles 22/07

DDT 11,4 U | Basal total 32 % | 3,6 U | Bolus total 68 % | 7,8 U { Bolus 91 % | 7,1 u + Autocorrección 9 % | 0,7 u }

Cambiar eg. infusión

Tiempo en rango: 3% / 97%

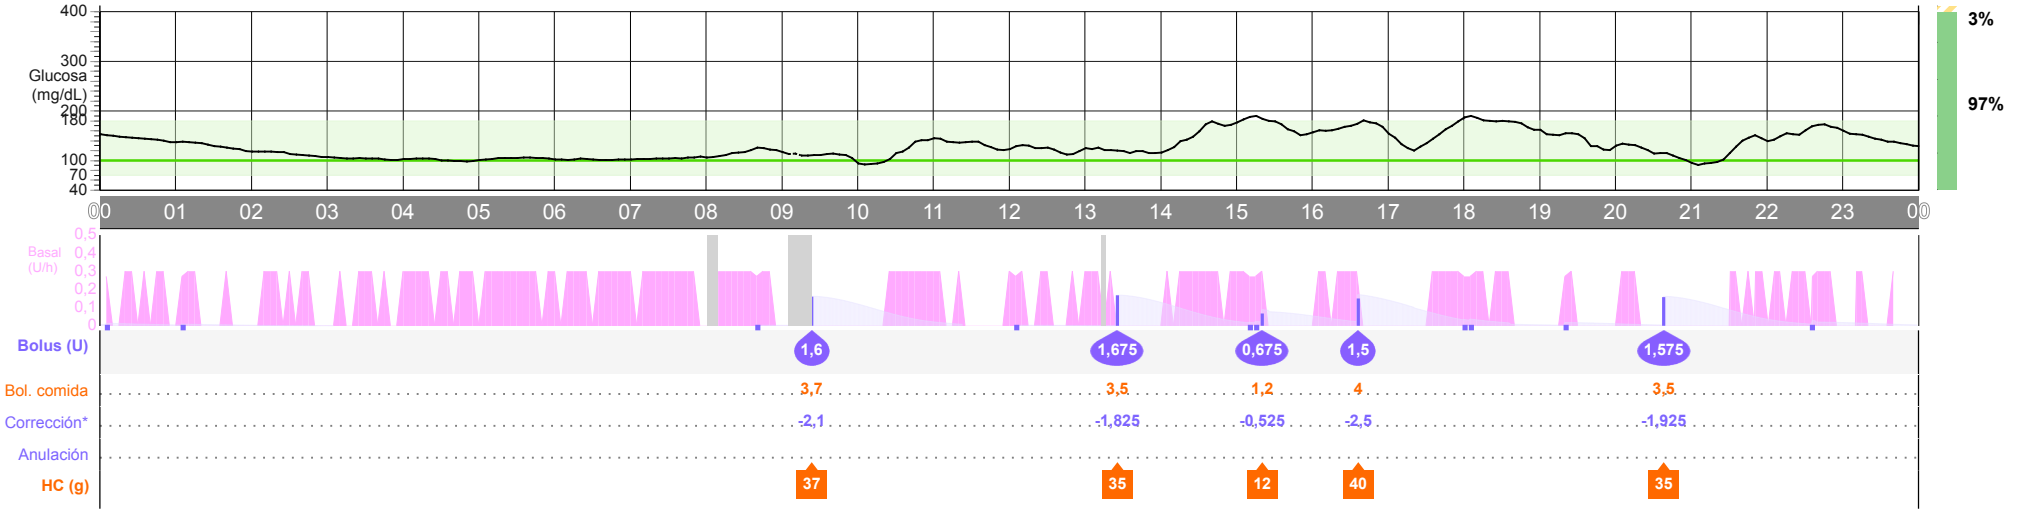

Jueves 23/07

DDT 11,3 U | Basal total 32 % | 3,6 U | Bolus total 68 % | 7,7 U { Bolus 99 % | 7,6 u + Autocorrección 1 % | 0,1 u }

Tiempo en rango: 7% / 93%

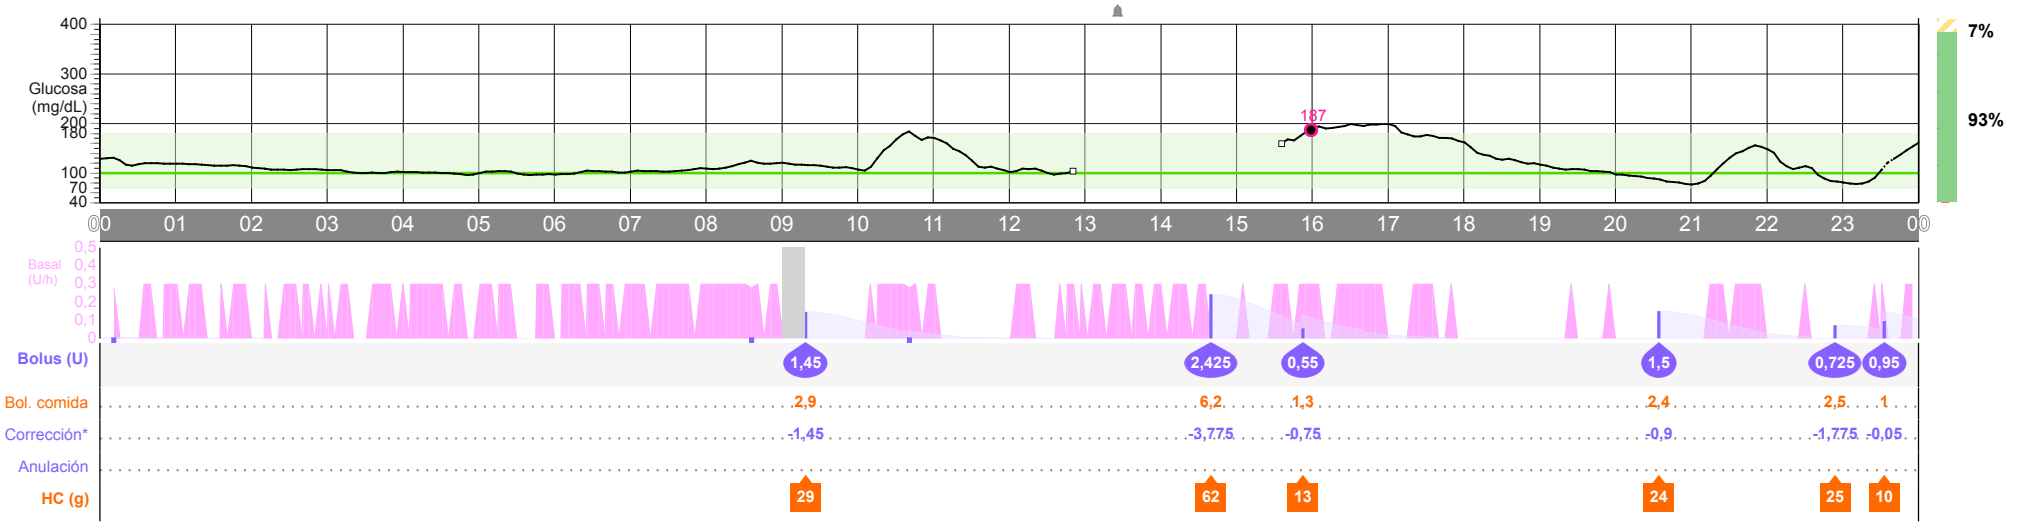

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre · Calibración · Autobasal · Susp. límite bajo · Basal · Susp. antes lím. bajo · Basal temporal · Alertas · Autocorrección + Insulina activa · Retr. rec. sensor · Bolus + Insulina activa · Objetivo + objet. temp. · Cambio de hora · Fuera gráfico · Modo Manual · Suspensión manual · Tiempo en rango (mg/dL) 50 70 180 250

Viernes 24/07

DDT 10,7 U | Basal total 35 % | 3,7 U | Bolus total 65 % | 7,0 U { Bolus 81 % | 5,7 u + Autocorrección 19 % | 1,3 u }

Cambiar eq. infusión

Tiempo en rango

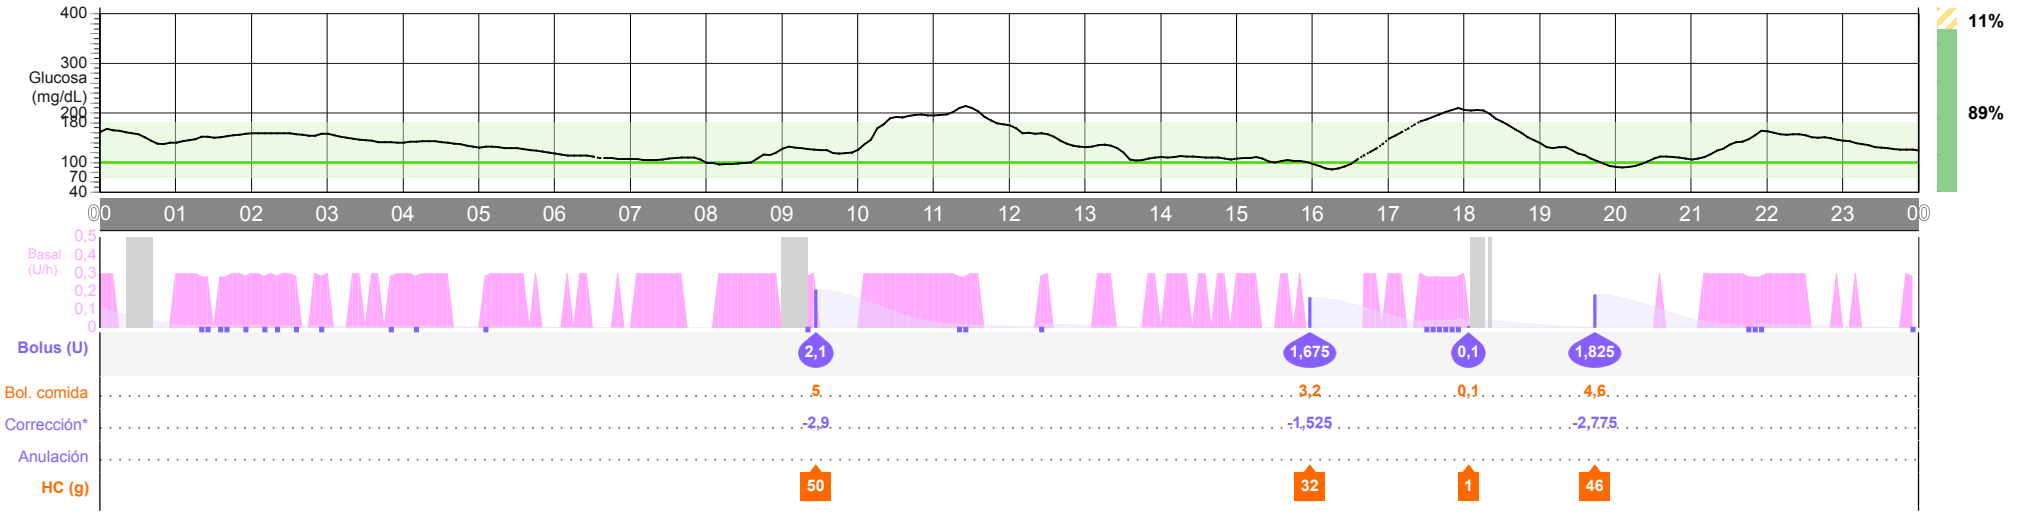

Sábado 25/07

DDT 11,4 U | Basal total 24 % | 2,7 U | Bolus total 76 % | 8,7 U { Bolus 97 % | 8,4 u + Autocorrección 3 % | 0,3 u }

Tiempo en rango

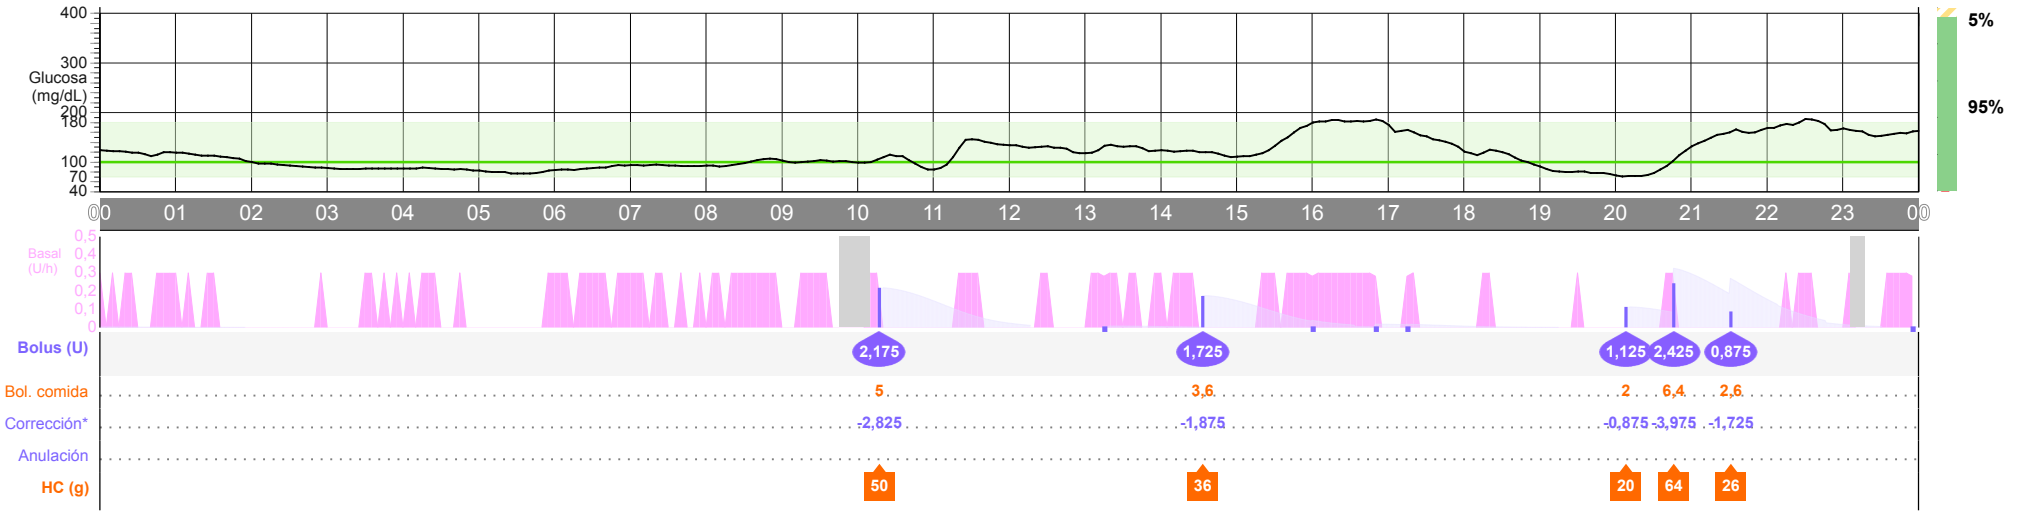

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 50 70 180 250

Domingo 26/07

DDT 10,2 U | Basal total 35 % | 3,6 U | Bolus total 65 % | 6,6 U { Bolus 65 % | 4,3 u + Autocorrección 35 % | 2,3 u }

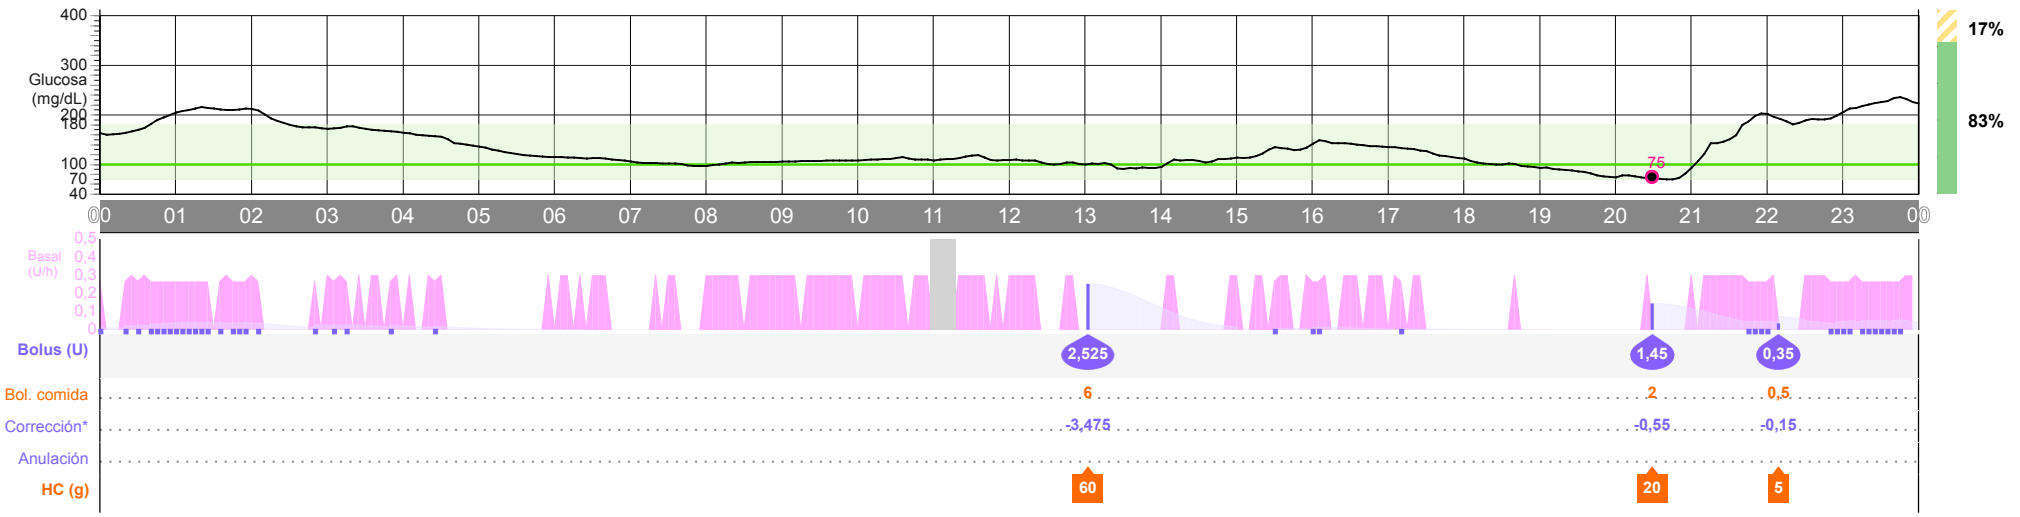

Lunes 27/07

DDT 11,1 U | Basal total 29 % | 3,2 U | Bolus total 71 % | 7,9 U { Bolus 75 % | 5,9 u + Autocorrección 25 % | 2,0 u }

Cambiar eq. infusión

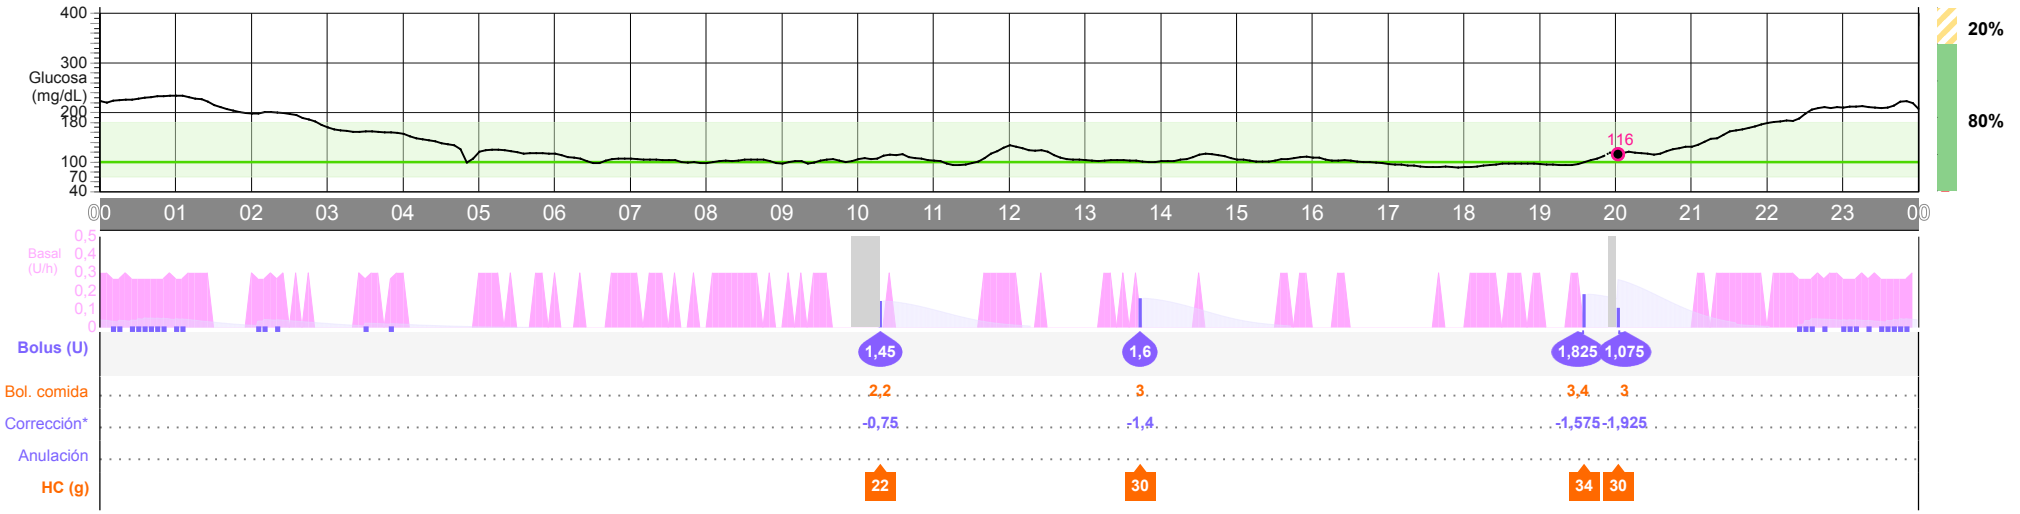

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre | Calibración | Autobasal | Susp. límite bajo | Basal | Susp. antes lím. bajo | Basal temporal | Alertas | Autocorrección + Insulina activa | Retr. rec. sensor | Bolus + Insulina activa | Objetivo + objet. temp. | Cambio de hora | Fuera gráfico | Modo Manual | Suspensión manual | Tiempo en rango (mg/dL) 50 70 180 250

Martes 28/07

DDT 10,6 U | Basal total 28 % | 3,0 U | Bolus total 72 % | 7,6 U { Bolus 96 % | 7,3 u + Autocorrección 4 % | 0,3 u }

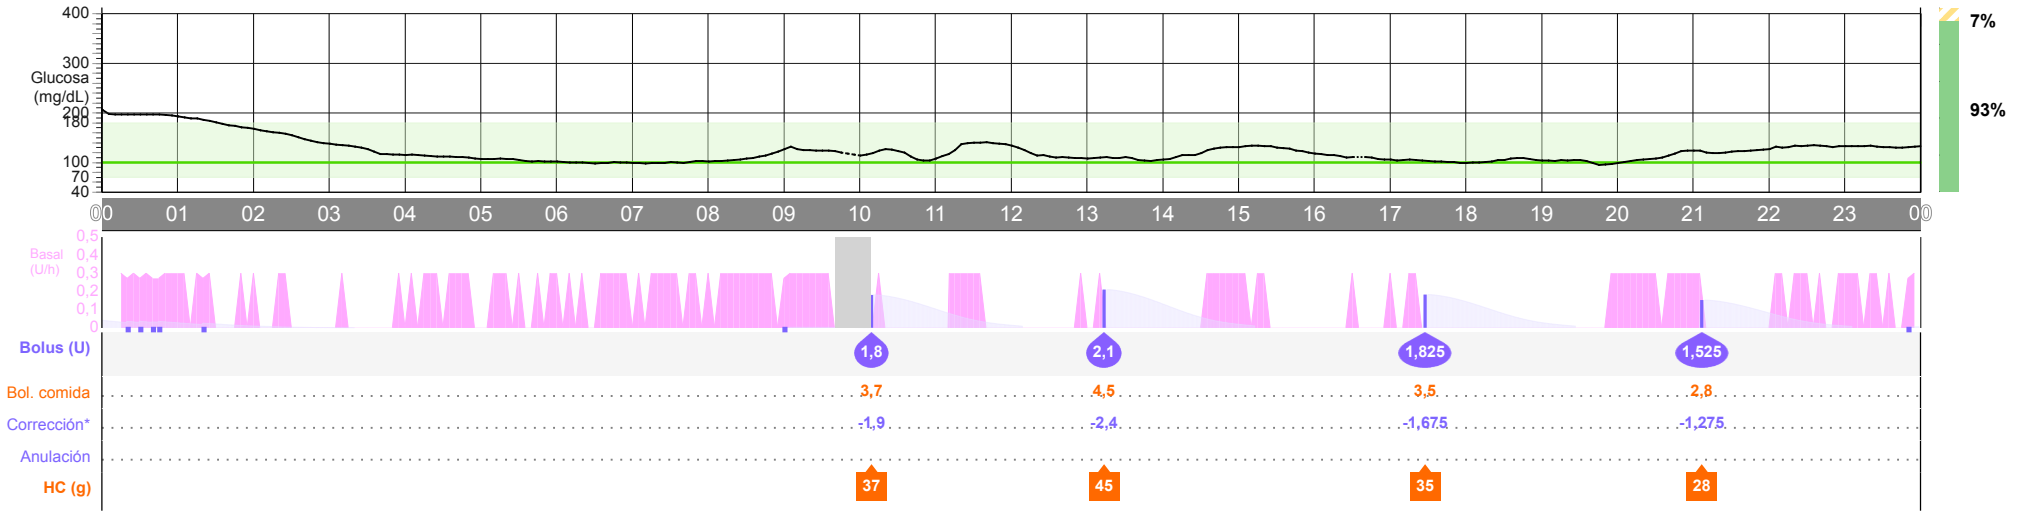

Miércoles 29/07

DDT -- | Basal total -- | -- | Bolus total -- | -- { Bolus -- | -- + Autocorrección -- | -- }

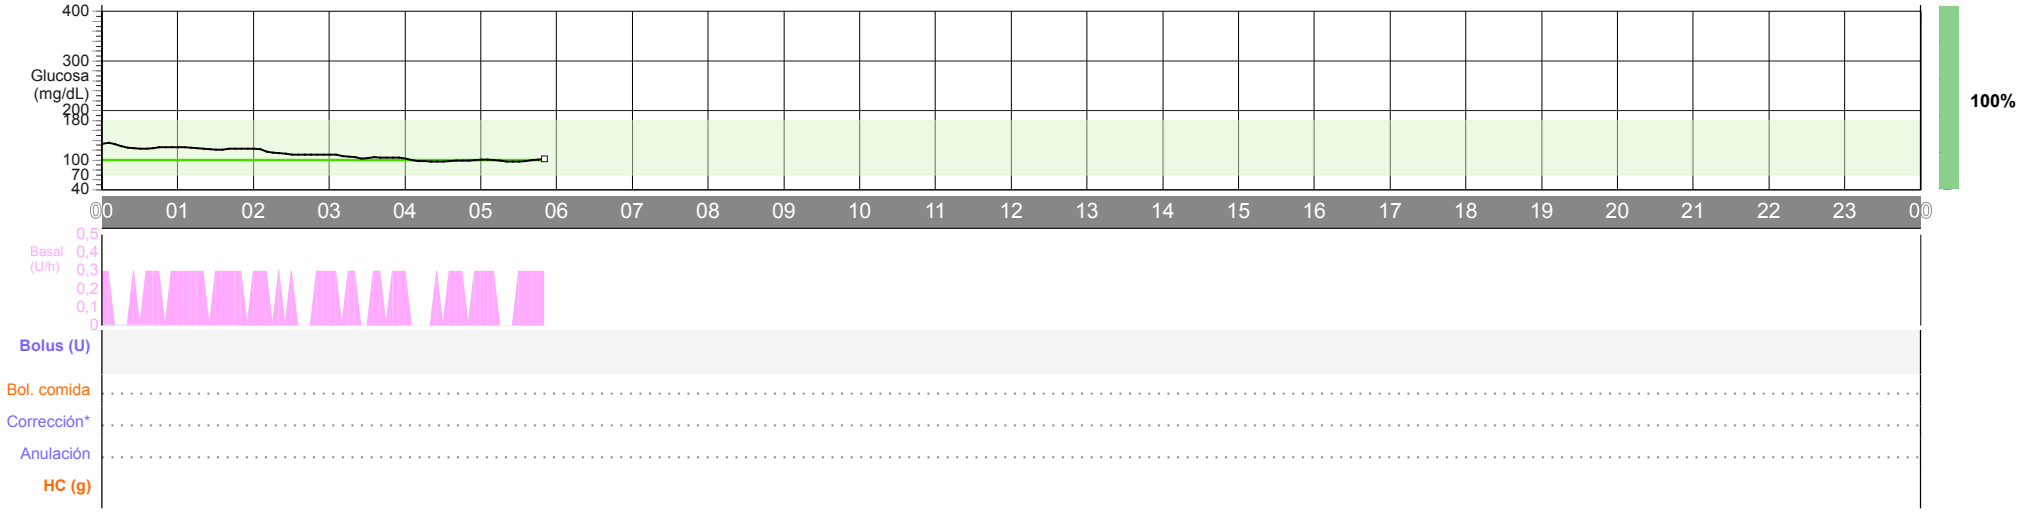

*Insulina activa considerada. SmartGuard también considera el ajuste de bolus de SmartGuard.

Glucosa sangre
Calibración
Autobasal
Susp. límite bajo
Basal
Susp. antes lím. bajo
Basal temporal
Alertas
Autocorrección + Insulina activa
Retr. rec. sensor
Bolus + Insulina activa
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Fuera gráfico
Modo Manual
Suspensión manual
Tiempo en rango (mg/dL)
50 70 180 250