

Detalles sobre la razón de la finalización

Glucosa en sangre
Calibración
Autobasal
Basal
Susp. límite bajo
Susp. antes de límite bajo
Autocorrección + Insulina activa
Bolus + Insulina activa
Modo Manual
Suspen. manual
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Retr. rec. sensor

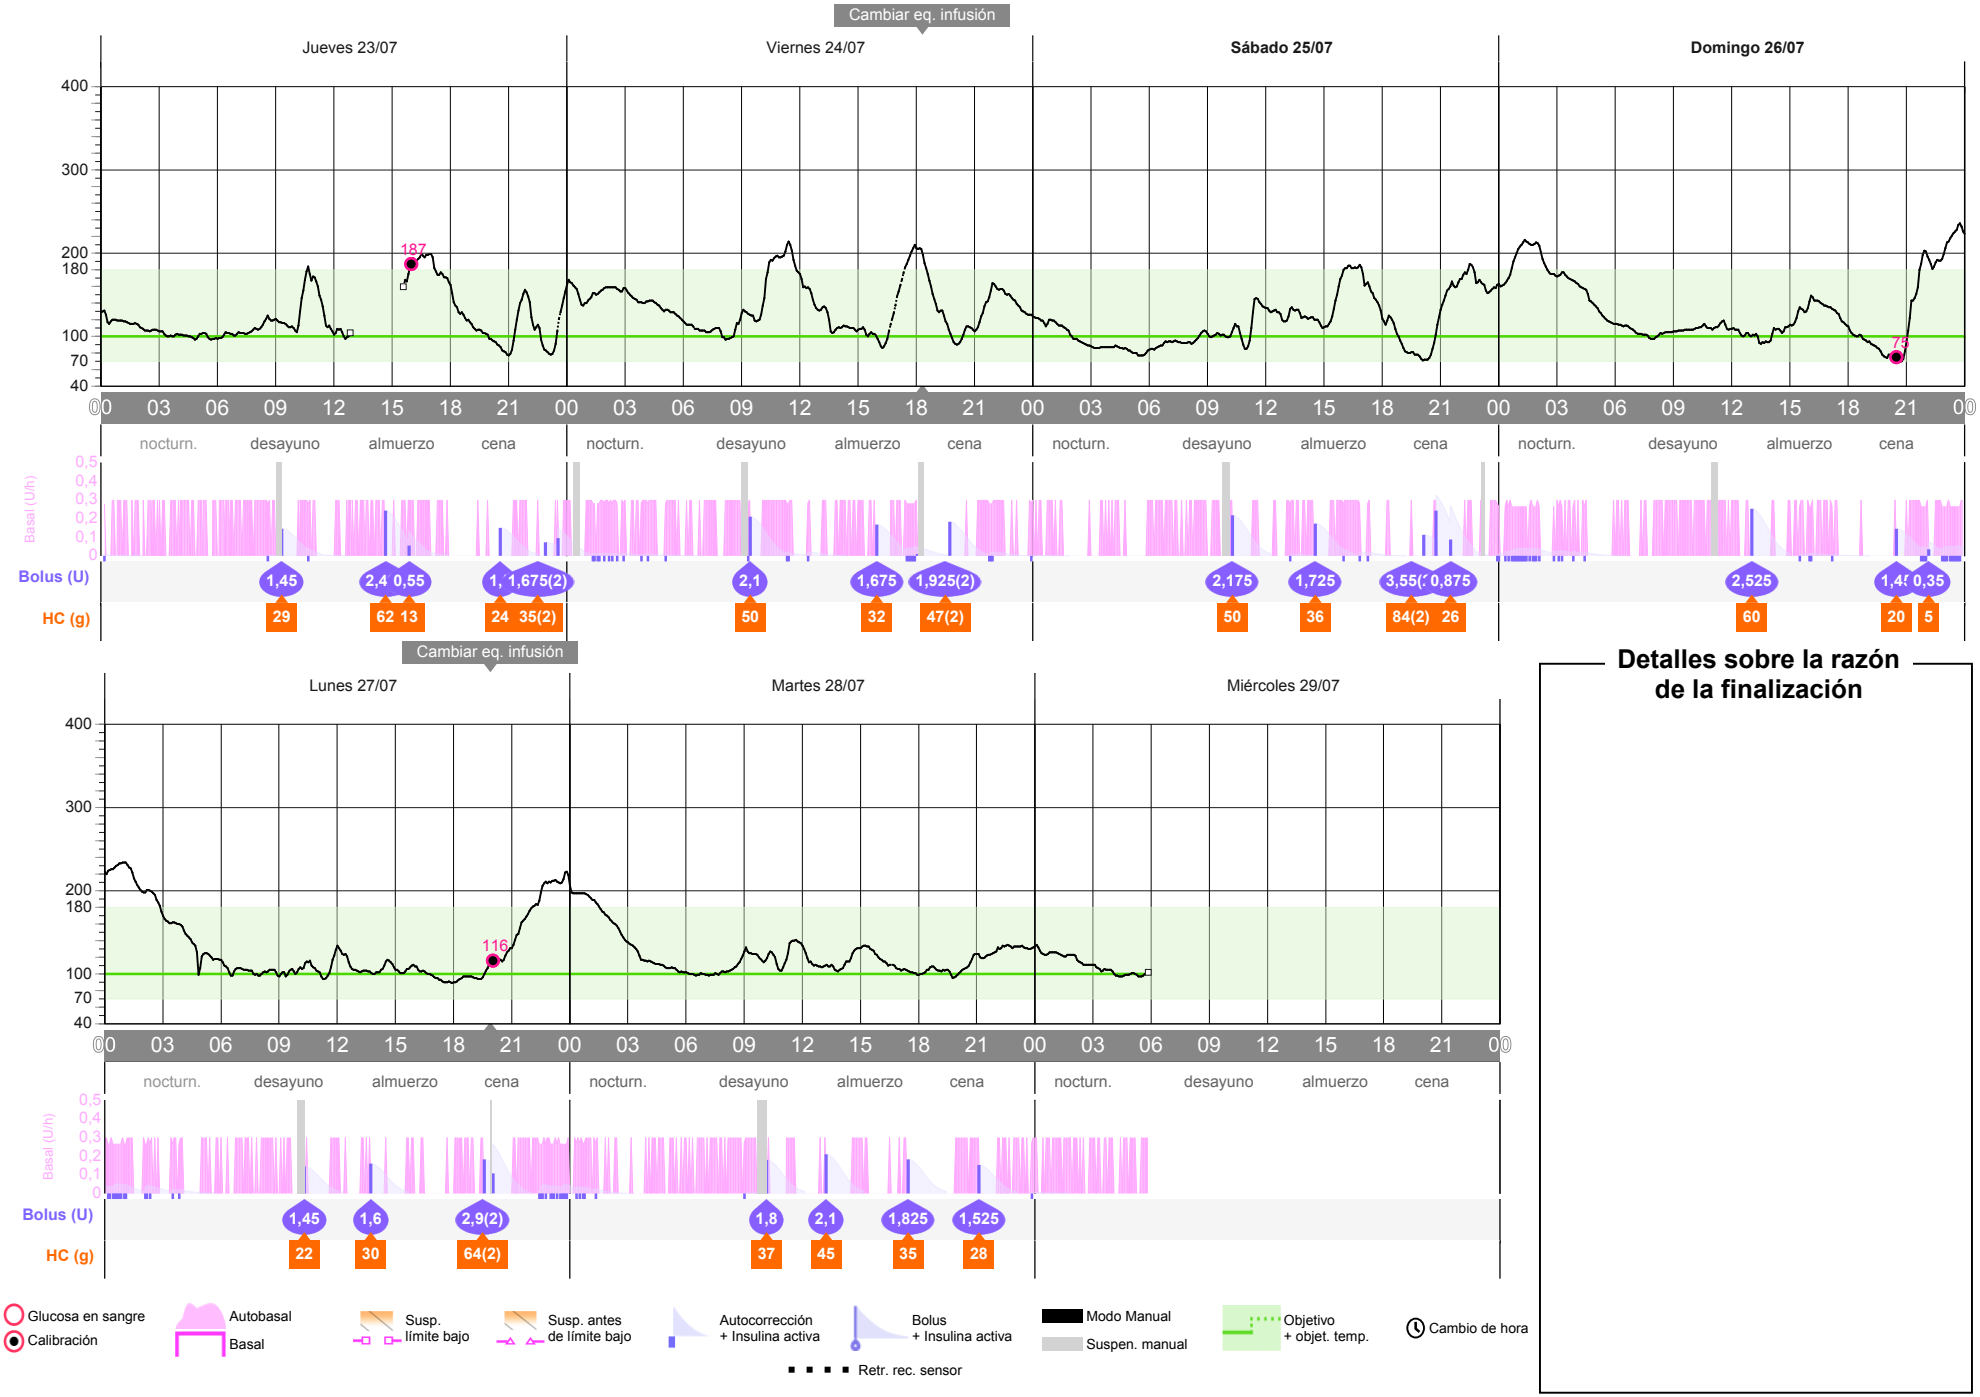

Detalles sobre la razón de la finalización

Glucosa en sangre
Calibración
Autobasal
Basal
Susp. límite bajo
Susp. antes de límite bajo
Autocorrección + Insulina activa
Bolus + Insulina activa
Modo Manual
Suspen. manual
Objetivo + objet. temp.
Cambio de hora
Retr. rec. sensor